

- ✓ Ciascun Commissario verifica che la Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A propone un piano di formazione approfondito e definito nei dettagli, che risulta pienamente confacente alla realtà del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Ciascun Commissario verifica che la società Elettrobiocchimica dispone di un team di riferimento ottimamente qualificato. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che la Elitechgroup S.P.A. dispone di un supporto di livello sufficiente alle esigenze del servizio; giudizio complessivo: SUFFICIENTE (0,20).
- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che la Società Nuclear Laser Medicine propone un supporto specialistico di livello sufficiente in relazione alle necessità richieste. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE (0,20).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che la Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A dispone di un team di riferimento ottimamente qualificato. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Sostenibilità ambientale:

- ✓ Ciascun Commissario valuta ottimamente l'impegno in materia di sostenibilità della Società Elettrobiocchimica. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00)
- ✓ Ciascun Commissario verifica che la strumentazione proposta dalla Elitechgroup S.P.A. produce quantitativi di rifiuti consumabili di entità non trascurabile. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE (0,20)
- ✓ Ciascun Commissario verifica che la Società Nuclear Laser Medicine attua adeguate politiche di sostenibilità ambientale. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,60)
- ✓ Ciascun Commissario valuta ottimamente l'impegno in materia di sostenibilità della Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

 Criterio di valutazione 	 Punteggio Elettrobiocchimica srl 	 Punteggio ELITECHGROUP S.p.A. 	 Punteggio Nuclear Laser Medicine 	 Punteggio ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A
Modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto	5,00	0,00	1,00	4,00
Flessibilità operativa	2,00	0,80	0,80	2,00
Ergonomia del sistema	2,00	0,00	0,40	1,20
Middleware strumentale	2,00	0,00	0,40	2,00
Progetto di formazione	3,00	1,80	0,60	3,00
Supporto specialistico offerto	2,00	0,40	0,40	2,00
Sostenibilità ambientale	2,00	0,40	0,80	2,00

Mf Q BX

La Commissione pertanto assegna il punteggio tecnico totale alle Società partecipanti al lotto n. 18, in particolare:

Società Elettrobiochimica srl

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 7,94 + 35,00 + 18,00 = 60,94

Società ELITECHGROUP S.P.A

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 6,69 + 30,00 + 3,40 = 40,09

Società Nuclear Laser Medicine

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 7,83 + 35,00 + 4,40 = 47,23

Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 7,58 + 33,00 + 16,20 = 56,78

Terminata la valutazione del Lotto n. 18, la Commissione prosegue i lavori con la disamina tecnica del lotto n. 4 relativo al "Sistema integrativo per sierologia microbica e virale".

Preliminarmente, si prende visione delle specifiche tecniche a pena esclusione contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato 3.1 per quanto concerne il lotto in esame. Successivamente, si procede alla lettura dei chiarimenti pervenuti in relazione a tale lotto, verificando che in alcun modo questi alterino il capitolato.

Si procede pertanto ad esaminare la documentazione presentata dalle sotto indicate Società offerenti, valutando la conformità a quanto specificato nel Disciplinare:

- BioMérieux Italia SPA
- ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A

La Commissione riscontra che le offerte presentate dalle suindicate società partecipanti sono rispondenti ai requisiti minimi richiesti.

Successivamente, si procede con la rilevazione dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8.

Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti dalle società BIOMÉRIEUX ITALIA SPA e ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato.

Criteri Quantitativi

Criterio di valutazione	Punteggio BioMérieux Italia SPA	Punteggio ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A
Grado di completezza dei riferimenti del lotto	4,00	3,40
Ridotta rumorosità della strumentazione offerta	2,00	1,94
Tempo/operatore dedicato nel workflow dell'inserimento di un esame (ovvero di un singolo parametro per un singolo paziente)	3,00	1,50
Tempo/operatore dedicato alla manutenzione giornaliera	3,00	3,00

Mf *OS* *OX*

Criteri Tabellari

Criterio di valutazione	Punteggio BioMérieux (Italia SPA)	Punteggio ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A
Presenza di analizzatore da bancone	3,00	3,00
Sistema di identificazione del tubo primario con barcode	3,00	3,00
Sistema di identificazione reagenti con barcode	3,00	3,00
Lavorazione random access	3,00	3,00
Capacità di lavorare più parametri simultaneamente	3,00	3,00
Calibrazioni memorizzate	1,00	1,00
Capacità di inserire campioni in urgenza	4,00	4,00
Software in grado di gestire i controlli interni e il QC esterno di terza parte	2,00	2,00
Gestione test immunoenzimatici colorimetrici	0,00	0,00
Gestione test immunoenzimatici fluorimetrici	3,00	0,00
Gestione test in chemiluminescenza	0,00	1,00
Assistenza e manutenzione strumentale da remoto	4,00	4,00
Estensione al sabato e giorni festivi dei termini di capitolato per il ripristino della totale funzionalità della macchina	2,00	2,00
Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema	2,00	2,00
Possibilità di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati	2,00	2,00
Scarico automatico reagenti e/o cartucce	2,00	0,00
Sistema di tracciamento degli ordini di kit e materiali fruibile dall'utilizzatore	2,00	2,00

La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica al fine di valutare i seguenti aspetti:

Modalità di gestione e di implementazione del sistema:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che Il progetto proposto dalla Società BioMérieux Italia SPA rispecchia completamente le esigenze in quanto prevede la consegna e l'installazione della strumentazione e una prima sessione di formazione in una sola giornata, senza alcun blocco delle attività. Giudizio attribuito da ciascun commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che la ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A propone un progetto di implementazione ben descritto ed illustrato. Giudizio attribuito da ciascun commissario: BUONO (0,80).

Mf *Q* *Q*

Ergonomia del sistema:

- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che l'ingombro del sistema proposto dalla Società BioMérieux Italia SPA è minimo (lunghezza inferiore a 1 m), quindi ottimamente rispondente alle esigenze del servizio. Giudizio attribuito da ciascun commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che lo strumento offerto dalla ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A presenta una lunghezza di poco inferiore a 2 metri. Giudizio attribuito da ciascun commissario: ADEGUATO (0,60).

Middleware strumentale:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che il software offerto dalla middleware fornito dalla Società BioMérieux Italia SPA ha caratteristiche funzionali ben appropriate alle attività del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun commissario: BUONO (0,80).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che la Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A propone uno strumento di middleware ottimamente strutturato. Giudizio attribuito da ciascun commissario: OTTIMO (1,00).

Qualità e consistenza del progetto formativo offerto:

- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che l'attività formativa della BioMérieux Italia SPA propone un piano di formazione approfondito per tutti gli operatori del servizio, garantendo una perfetta conformità alle richieste del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che la Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A propone un piano di formazione approfondito per tutti gli operatori del servizio, garantendo una perfetta conformità alle richieste del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun commissario: OTTIMO (1,00).

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Ciascun Commissario rileva che la società BioMérieux Italia SPA dispone per il laboratorio una figura di riferimento dedicata esclusivamente a supporto delle attività della commessa. Giudizio attribuito da ciascun commissario: BUONO (0,80).
- ✓ Ciascun Commissario rileva che la Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A offre un supporto specialistico ottimamente composto (5 Specialist Applicativi Con residenza nella città di Roma) in grado di garantire un rapido ed efficiente intervento presso la struttura del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun commissario: OTTIMO (1,00).

Sostenibilità ambientale:

- ✓ Ciascun Commissario che la società BioMérieux Italia SPA applica politiche puntuali di sostenibilità ambientale. Giudizio attribuito da ciascun commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario che la società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A applica politiche puntuali di sostenibilità ambientale. Giudizio attribuito da ciascun commissario: OTTIMO (1,00).

Criterio di valutazione	Punteggio BioMérieux Italia SPA	Punteggio ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

M. Q. D. N.

Modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto	5,00	4,00
Ergonomia del sistema: efficienza nell'utilizzo degli spazi assegnati	2,00	1,20
Middleware strumentale	2,40	3,00
Qualità e consistenza del percorso formativo offerto	3,00	3,00
Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web)	1,60	2,00
Sostenibilità ambientale	2,00	2,00

La Commissione pertanto assegna il punteggio tecnico totale alle Società partecipanti al lotto n. 4, in particolare:

Società BioMérieux Italia SPA

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 12,00 + 39,00 + 16,00 = 67,00

Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 9,84 + 35,00 + 15,20 = 60,04

Terminata la valutazione del Lotto n. 4, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 17:40.


Letto, confermato e sottoscritto


PRESIDENTE Dott.ssa Maria Letizia Schiavone

COMPONENTE Dott.ssa Annunziata Tamburro

COMPONENTE Ing. Mariasole Giacummo









Procedura aperta telematica in ambito comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura per 60 mesi in service di "sistemi macchina reagenti occorrenti al laboratorio di microbiologia"

**Verbale n. 8 seduta riservata
 15/01/2021
 Dalle ore 09:00 alle ore 12:30**

Il giorno 15/01/2021 alle ore 09:00, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL Roma 1 si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 677 del 04/08/2020, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 325 del 14/04/2020, modificata con Deliberazione n. 400 del 20/05/2020.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE	Dott.ssa Maria Letizia Schiavone	Dirigente Biologo UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Dott.ssa Annunziata Tamburro	Coordinatore Tecnico UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Ing. Mariasole Giacommo	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7, continua con la disamina tecnica.

La Commissione riprende i lavori iniziando la disamina tecnica del lotto n. 9 relativo a "Reagenti per ricerche antigeniche rapide su feci".

Preliminarmente, si prende visione delle specifiche tecniche a pena esclusione contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato 3.1 per quanto concerne il lotto in esame.

Si procede pertanto ad esaminare la documentazione presentata dalle sotto indicate Società offerenti, valutando la conformità a quanto specificato nel Disciplinare:

- ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
- D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA
- MASCIA BRUNELLI S.p.A
- MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL
- RECORD SEPARATION S.R.L

La Commissione riscontra che le offerte presentate dalle suindicate società partecipanti sono rispondenti ai requisiti minimi richiesti.

Successivamente, si procede con la rilevazione dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8.

Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti dalle società sopramenzionate, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato.

Criteri Quantitativi

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	Punteggio D.I.D. S.P.A	Punteggio MASCIA BRUNELLI S.p.A	Punteggio Meridian Bioscience Europe Srl	Punteggio Record Separation S.r.l
Grado di completezza dei riferimenti del lotto	5,00	4,50	5,00	5,00	5,00

(Handwritten signatures)

Sensibilità analitica per Rotavirus Ag	1,98	1,94	1,98	2,00	1,94
Sensibilità analitica per Adenovirus Ag	1,98	1,90	1,98	2,00	1,90
Sensibilità analitica per Norovirus Ag	1,82	2,00	1,98	2,00	1,92
Sensibilità analitica per Clostridium difficile Ag comune (GDH)	1,62	2,00	2,00	2,00	2,00
Sensibilità analitica per Clostridium difficile tossina A	1,78	2,00	2,00	2,00	1,98
Sensibilità analitica per Clostridium difficile tossina B	1,78	2,00	2,00	2,00	1,98
Turnaround Time del test per Cdiff GDH (dall'inoculo del supporto alla lettura)	1,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Turnaround Time del test per Cdiff tossine (dall'inoculo del supporto alla lettura)	1,60	4,00	4,00	2,68	4,00
Sensibilità analitica per Helicobacter pylori Ag (HPSA)	1,80	1,96	1,98	2,00	2,00
Sensibilità analitica per Cryptosporidium parvum Ag	2,00	1,96	2,00	2,00	1,92
Sensibilità analitica per Giardia spp. Ag	1,96	1,90	2,00	2,00	1,92
Sensibilità analitica per Entamoeba histolytica	2,00	1,94	0,00	2,00	1,90
Sensibilità analitica per Entamoeba histolytica o dispar Ag	2,00	1,94	1,98	2,00	1,90
Sensibilità analitica per ricerca diretta E. coli O157:H7	1,98	1,98	2,00	0,00	1,98
Sensibilità analitica per altre tossine Shiga direttamente nelle feci	1,98	0,00	0,00	0,00	2,00
Sensibilità analitica per altre tossine Shiga dopo coltura	1,98	0,00	0,00	1,72	2,00

Criteria Tabellari

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	Punteggio D.I.D. S.P.A	Punteggio MASGIA BRUNELLI S.p.A	Punteggio Meridian Bioscience Europe Srl	Punteggio Record Separation S.r.l.
Formulazione come "monotest"	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

[Handwritten signature]

Metodo immunocromatografico rapido	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Capacità di identificare Entamoeba histolytica	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Capacità di identificare E. coli O157:H7 direttamente nelle feci	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Capacità di rilevare altre tossine Shiga direttamente nelle feci	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Capacità di rilevare tossine Shiga dopo coltura	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Restituzione di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00


La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica al fine di valutare i seguenti aspetti:

Offerta complessivamente presentata:

- ✓ Ciascun Commissario valuta l'offerta presentata dalla Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL rispecchia ottimamente le esigenze per quanto concerne le modalità di agevolazione della raccolta di analiti, nonché per la riduzione delle manipolazioni e l'igiene associata a queste. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta l'offerta presentata dalla Società D.I.D. S.P.A è ottimamente rispondente alle esigenze per quanto concerne le modalità di agevolazione della raccolta di analiti, nonché per la riduzione delle manipolazioni e il rispetto dell'igiene. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta l'offerta presentata dalla MASCIA BRUNELLI S.p.A ben appropriata in relazione alle esigenze del laboratori. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che l'offerta presentata dalla Società Meridian Bioscience Europe Srl rispecchia ottimamente le esigenze per quanto concerne le modalità di agevolazione della raccolta di analiti, nonché per la riduzione delle manipolazioni e l'igiene associata a queste. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta che l'offerta proposta dalla Record Separation S.r.l rispecchia sufficientemente le esigenze del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE (0,20).

Qualità e consistenza del percorso formativo offerto:

- ✓ Ciascun Commissario valuta il progetto formativo elaborato dalla Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL ottimamente corrispondente alle esigenze per gli aspetti di raggiungimento dell'autonomia, di mantenimento e di continuità di aggiornamento delle competenze del personale utilizzatore. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

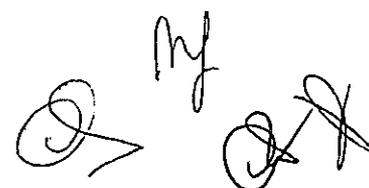



- ✓ Ciascun Commissario valuta il progetto formativo elaborato dalla Società D.I.D. S.P.A. ottimamente appropriato alle esigenze per gli aspetti di raggiungimento dell'autonomia, del mantenimento e della continuità di aggiornamento delle competenze del personale utilizzatore. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta il progetto formativo della MASCIA BRUNELLI S.p.A. discreto in merito alle esigenze per gli aspetti di raggiungimento dell'autonomia, del mantenimento e della continuità di aggiornamento delle competenze del personale utilizzatore. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: discreto (0,40).
- ✓ Ciascun Commissario valuta il progetto formativo elaborato dalla Società Meridian Bioscience Europe Srl ottimamente appropriato alle esigenze per gli aspetti di raggiungimento dell'autonomia e al mantenimento e continuità di aggiornamento delle competenze del personale utilizzatore. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta il progetto della Società Record Separation S.r.l. discreto rispetto alle esigenze connesse al raggiungimento dell'autonomia, del mantenimento e della continuità di aggiornamento delle competenze del personale utilizzatore. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO (0,40).

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che le competenze degli specialist proposta dalla Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL risultano ottimamente approfondite. Per quanto attiene alle risorse bibliografiche messe a disposizione degli operatori, i Commissari valutano la proposta offerta ottimamente in linea alle esigenze del servizio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che le competenze degli specialist proposta dalla Società D.I.D. S.P.A. risulta ottimamente approfondita, anche per quanto attiene alle risorse bibliografiche messe a disposizione degli operatori. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta che la ditta MASCIA BRUNELLI S.p.A. offre un supporto specialistico sufficiente in relazione alle esigenze del servizio operatori. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE (0,20).
- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che le competenze degli specialist proposta dalla Meridian Bioscience Europe Srl risultano estremamente approfondite. Per quanto attiene alle risorse bibliografiche messe a disposizione degli operatori, i Commissari valutano la proposta offerta ottimamente in linea alle esigenze del servizio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ La disamina della documentazione proposta dalla Record Separation S.r.l. ciascun Commissario evidenzia un grado di approfondimento del supporto specialistico proposto sufficiente in relazione alle esigenze del servizio operatori. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE (0,20).

Sostenibilità ambientale:

- ✓ la Commissione evidenzia che la Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL presenta un ottimo livello di sostenibilità ambientale, attraverso l'attuazione di politiche atte alla riduzione degli scarti prodotti dai campioni. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

- ✓ la Commissione evidenzia che la Società D.I.D. S.P.A presenta un ottimo livello di sostenibilità ambientale, attraverso l'attuazione di politiche atte alla riduzione degli scarti prodotti dai campioni. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ la Commissione valuta un discreto livello di sostenibilità ambientale della Società MASCIA BRUNELLI S.p.A, L'operatore in particolare dichiara di prediligere fornitori certificati ISO 9001:2005 e 14001. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO (0,40).
- ✓ La Commissione le politiche in materia di sostenibilità ambientali applicate dalla Società Record Separation S.r.l sufficienti. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE (0,20).

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	Punteggio D.I.D. S.P.A	Punteggio MASCIA BRUNELLI S.p.A	Punteggio Meridian Bioscience Europe Srl	Punteggio Record Separation S.r.l
Offerta complessivamente presentata per questo lotto	4,00	4,00	3,20	4,00	0,80
Qualità e consistenza del percorso formativo offerto	3,00	3,00	1,20	3,00	1,20
Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web)	2,00	2,00	0,40	2,00	0,40
Sostenibilità ambientale	2,00	2,00	0,80	2,00	0,40

La Commissione pertanto assegna il punteggio tecnico totale alle Società partecipanti al lotto n. 9, in particolare:

Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 34,86 + 18,00 + 11,00 = 63,86$$

Società D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 36,02 + 14,00 + 11,00 = 61,02$$

Società MASCIA BRUNELLI S.p.A

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 34,90 + 16,00 + 5,60 = 56,50$$

Società Meridian Bioscience Europe Srl

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 35,40 + 14,00 + 11,00 = 60,40$$

Società Record Separation S.r.l

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 40,34 + 18,00 + 2,80 = 61,14$$

Terminata la valutazione del Lotto n. 9, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 12:30.

Letto, confermato e sottoscritto



PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Letizia Schiavone

Maria Letizia Schiavone

COMPONENTE

Dott.ssa Annunziata Tamburro

Annunziata Tamburro

COMPONENTE

Ing. Mariasole Giacommo

Mariasole Giacommo

Q

Procedura aperta telematica in ambito comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura per 60 mesi in service di "sistemi macchina reagenti occorrenti al laboratorio di microbiologia"

Verbale n. 9 seduta riservata

21/01/2021

Dalle ore 09:30 alle ore 18:00

Il giorno 21/01/2021 alle ore 09:30, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL Roma 1 si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 677 del 04/08/2020, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 325 del 14/04/2020, modificata con Deliberazione n. 400 del 20/05/2020.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE	Dott.ssa Maria Letizia Schiavone	Dirigente Biologo UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Dott.ssa Annunziata Tamburro	Coordinatore Tecnico UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Ing. Mariasole Giacommo	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, continua con la disamina tecnica.

La Commissione riprende i lavori iniziando la disamina tecnica del lotto n. 13 relativo alla fornitura di "Reagenti e accessori per ricerche anticorpali su striscia".

Preliminarmente, si prende visione delle specifiche tecniche a pena esclusione contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato 3.1 per quanto concerne il lotto in esame.

Si procede pertanto ad esaminare la documentazione presentata dalle sotto indicate Società offerenti, valutando la conformità a quanto specificato nel Disciplinare:

- 'ARNIKA o anche 'ARNICA S.r.l
- FUJIREBIO ITALIA S.R.L

La Commissione riscontra che le offerte presentate dalle suindicate società partecipanti sono rispondenti ai requisiti minimi richiesti.

Successivamente, si procede con la rilevazione dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8. Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti dalle società 'ARNIKA S.r.l e FUJIREBIO ITALIA S.R.L, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato.

Criteri Quantitativi

Criterio di valutazione	Punteggio 'ARNIKA S.r.l	Punteggio Fujirebio Italia S.r.l
Numero di metodiche immunoblot offerte	2,57	3,00
Grado di completezza dei riferimenti del lotto	4,00	3,33

[Handwritten signatures and initials]



Tempo/operatore dedicato nel <i>workflow</i> dell'inserimento di un esame (ovvero di un singolo parametro per un singolo paziente)	3,00	1,50
Tempo/operatore dedicato alla manutenzione giornaliera	3,00	3,00

Criteria Tabellari

Criterio di valutazione	Punteggio ARNIKA S.r.l.	Punteggio Fujirebio Italia S.r.l.
Sistema completamente automatico, dall'inoculo del campione alla disponibilità della striscia per la lettura	3,00	3,00
Coniugati pronti all'uso	0,00	5,00
Disponibilità di protocolli di incubazione abbreviati (non necessariamente overnight)	3,00	3,00
Offerta di scanner (e software) per lettura ed interpretazione delle strisce	3,00	3,00
Strumento programmabile (per uso aperto, con metodiche terze)	4,00	4,00
Disponibilità di coniugato IgM (oltre che IgG) per <i>Treponema pallidum</i>	2,00	2,00
Disponibilità di coniugato IgM (oltre che IgG) per CMV	2,00	0,00
Disponibilità di coniugato IgM (oltre che IgG) per EBV	2,00	2,00
Analizzatore da bancone	2,00	2,00
Sistema di identificazione del tubo primario con barcode	2,00	2,00
Sistema di identificazione reagenti con barcode	2,00	0,00
Assistenza e manutenzione strumentale da remoto	0,00	0,00
Estensione al sabato e giorni festivi dei termini di capitolato per il ripristino della totale funzionalità della macchina	2,00	2,00
Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema	2,00	2,00
Possibilità di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati	2,00	2,00

La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica al fine di valutare i seguenti aspetti:

**Offerta complessivamente presentata per questo lotto:**

- ✓ Dall'analisi della documentazione ciascun Commissario giudica l'offerta presentata dalla Società 'ARNIKA S.r.l adeguata alle esigenze sia nelle fasi e che nelle modalità di implementazione del sistema. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,60).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che la Società Fujirebio Italia S.r.l propone un sistema la cui implementazione è estremamente semplice da attuare e aperta ad eventuali future richieste di test in immunoblot; giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Ergonomia del sistema - efficienza nell'utilizzo degli spazi assegnati:

- ✓ Ciascun Commissario valuta che il sistema offerto dalla 'ARNIKA S.r.l è compatto e risulta ben adeguato agli spazi assegnati al lotto in questione. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).
- ✓ Ciascun Commissario valuta che la Società Fujirebio Italia S.r.l offre un sistema ottimamente rispondente alle esigenze in quanto caratterizzato da ingombro minimo ed estrema accessibilità. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Middleware strumentale:

- ✓ Ciascun Commissario valuta che la Società 'ARNIKA S.r.l non presenta software. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: INSUFFICIENTE (0,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta che il sistema fornito dalla FUJIREBIO ITALIA S.R.L è interfacciabile a qualsiasi sistema di gestione. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Progetto di formazione:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che la Società 'ARNIKA S.r.l propone un piano di formazione sulla strumentazione adeguato rispetto alle esigenze del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,60).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che il progetto formativo della FUJIREBIO ITALIA Srl propone un piano di formazione su tutta la strumentazione di buon livello in relazione alle esigenze del servizio del laboratorio. In particolare prevede un corso di iniziale di 2 giorni con possibilità di ripetizioni successive. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Ciascun Commissario verifica che, dalla disamina della documentazione prodotta, la Società 'ARNIKA S.r.l offre un supporto specialistico sufficiente. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE (0,20).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che la Società Fujirebio Italia S.r.l offre un buon supporto specialistico sufficiente, attraverso la presenza di cinque tecnici specialistici. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).

Sostenibilità ambientale:

- ✓ Per quanto concerne le politiche atte al tema della sostenibilità ambientale, Ciascun Commissario valuta la sensibilità al tema della Società 'ARNIKA S.r.l di livello discreto, in particolare attraverso l'utilizzo del

sistema proposto che consente la riduzione delle sostanze di reflu. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,60).

- ✓ Ciascun Commissario valuta che la Società Fujirebio Italia S.r.l garantisce un ottimo grado di sensibilità al tema grazie alla presentazione di una certificazione aziendale. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Criterio di valutazione	Punteggio ARNIKA S.r.l	Punteggio Fujirebio Italia S.r.l
Modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto	3,00	5,00
Ergonomia del sistema: efficienza nell'utilizzo degli spazi assegnati	1,60	2,00
Middleware strumentale (fornire descrizione)	0,00	3,00
Progetto di formazione	1,80	1,80
Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web)	0,40	2,40
Sostenibilità ambientale	1,20	2,00

I punteggi tecnici complessivi ai 2 operatori partecipanti al Lotto 13 vengono pertanto così determinati

Società 'ARNIKA S.r.l

$$P_{tecnico} = P_{quantitativo} + P_{tabellare} + P_{discrezionale} = 12,57 + 31,00 + 8,00 = 51,57$$

Società Fujirebio Italia S.r.l

$$P_{tecnico} = P_{quantitativo} + P_{tabellare} + P_{discrezionale} = 10,83 + 32,00 + 17,00 = 58,83$$

Terminata la valutazione del Lotto n. 13, la Commissione prosegue i lavori con la disamina tecnica del lotto n. 11 relativo alla fornitura di "Reagenti per ricerche anticorpali su siero, mediante tecnologie diverse".

Si procede pertanto ad esaminare la documentazione presentata dal R.T.I. ALIFAX S.R.L – Dasit S.p.a., unico offerente del presente lotto, valutando la conformità a quanto specificato nel Disciplinare.

La Commissione riscontra che l'offerta presentata dal suindicato Raggruppamento è rispondente ai requisiti minimi richiesti.

Successivamente, si procede con la rilevazione dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8.

Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti dal R.T.I. ALIFAX S.R.L – Dasit S.p.a., attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato.

Criteri Quantitativi



Criterio di valutazione	Punteggio R.I.L. ALIFAX S.R.L. - Dasit S.p.a.
Stabilità sospensione emazie di saggio a 2°-8° C dopo ricostruzione (riferimento 12)	2,00
Stabilità sospensione emazie di controllo a 2°-8° C dopo ricostruzione (riferimento 12)	2,00
Stabilità sospensione emazie di saggio a 2°-8° C dopo ricostruzione (riferimento 15)	2,00
Stabilità sospensione emazie di controllo a 2°-8° C dopo ricostruzione (riferimento 15)	2,00
Sensibilità analitica riferimento 12	2,00
Sensibilità analitica riferimento 13	2,00
Sensibilità analitica riferimento 14	2,00
Sensibilità analitica riferimento 15	2,00
Sensibilità analitica riferimento 16	2,00
Volume di controllo positivo disponibile per singola confezione rif 12	2,00
Volume di controllo positivo disponibile per singola confezione rif 13	2,00
Volume di controllo positivo disponibile per singola confezione rif 14	2,00
Volume di controllo positivo disponibile per singola confezione rif 15	2,00
Volume di controllo positivo disponibile per singola confezione rif 16	2,00
Numero di sierotipi antigenici rilevabili per Legionella	3,00
Grado di completezza del lotto	4,00

Criteri Tabellari

Criterio di valutazione	Punteggio R.I.L. ALIFAX S.R.L. - Dasit S.p.a.
Sospensioni diagnostiche colorate (rif 1-11)	2,00
Sospensioni diagnostiche pronte all'uso (rif 1-11)	2,00
Offerta sieri di controllo (rif 1-11)	5,00
Criterio di valutazione	Punteggio R.I.L. ALIFAX S.R.L. - Dasit S.p.a.



Possibilità di effettuare screening su vetrino (rif 1-11)	4,00
Reagenti provenienti da un unico produttore (rif da 1 a 11)	2,00
Reagenti provenienti da un unico produttore (rif da 12 a 15)	0,00
Riferimento 16: metodica immununocromatografica o equivalente	2,00
Vetrini "compositi", ossia con C.pneumoniae + C.trachomatis + C.psittaci su gni spot (metodica MIF)	0,00
Possibilità di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati	2,00

La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica al fine di valutare i seguenti aspetti:

Offerta complessivamente presentata per questo lotto:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che il progetto proposto è perfettamente confacente alle esigenze del servizio dei laboratori. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Progetto di formazione:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che il R.T.I. Punteggio R.T.I. ALIFAX S.R.L – Dasit S.p.a. propone un piano di formazione approfondito e in linea con le necessità degli operatori. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Ciascun Commissario verifica che il supporto proposto dal Raggruppamento Temporaneo è assolutamente valido sia per quanto concerne i Curricula che per la bibliografia disponibile. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Sostenibilità ambientale:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che l'offerente presenta diverse dichiarazioni in materia di sostenibilità ambientale. La valutazione è in linea con il livello di sensibilità richiesto. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Criterio di valutazione	Punteggio R.T.I. ALIFAX S.R.L – Dasit S.p.a.
Offerta complessivamente presentata per questo lotto	4,00
Progetto di formazione	3,00
Supporto specialistico offerto	2,00
Sostenibilità ambientale	2,00

Mf O S

La Commissione pertanto assegna il punteggio tecnico totale al R.T.I. ALIFAX S.R.L – Dasit S.p.a., unico offerente per il Lotto n. 11, e in particolare:

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 35,00 + 19,00 + 11,00 = 65,00$$

Terminata la valutazione del Lotto n. 11, la Commissione prosegue i lavori con la disamina tecnica del lotto n. 14 relativo alla fornitura di "Reagenti per ricerche antigeniche rapide su urine, liquor, tamponi e sangue".

Preliminarmente, si prende visione delle specifiche tecniche a pena esclusione contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato 3.1 per quanto concerne il lotto in esame.

Si procede pertanto ad esaminare la documentazione presentata dalle sotto indicate Società offerenti, valutando la conformità a quanto specificato nel Disciplinare:

- ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
- DASIT S.p.A
- MASCIA BRUNELLI S.p.A
- Quidel Italy Srl
- Relab

La Commissione riscontra che le offerte presentate dalle suindicate società partecipanti sono rispondenti ai requisiti minimi richiesti.

Successivamente, si procede con la rilevazione dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8. Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti dalle società ABBOTT. RAPID DIAGNOSTICS SRL, DASIT S.p.A, MASCIA BRUNELLI S.p.A, Quidel Italy Srl e Relab, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato.

Criteri Quantitativi

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	Punteggio DASIT S.p.A	Punteggio MASCIA BRUNELLI S.p.A	Punteggio Quidel Italy Srl	Punteggio Relab
Grado di completezza dei riferimenti del lotto	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dimensioni dell'archivio storico strumentale	1,15	0,30	0,00	1,40	3,00
Numero di metodiche gestite dallo strumento	0,09	3,00	0,00	0,27	0,09
Sensibilità analitica del test per Legionella pneumophila	2,85	3,00	3,00	3,00	2,91
Sensibilità analitica del test per Streptococcus pneumoniae	2,73	2,79	3,00	2,94	2,88
Sensibilità analitica del test per Streptococcus pyogenes	2,91	3,00	2,82	2,89	2,88

Mf *OS* *PO*



Sensibilità analitica del test per Plasmodium falciparum/vivax	2,88	3,00	3,00	2,97	2,97
Turn around time del test per Legionella pneumophila (dall'inoculo della card al risultato strumentale)	1,96	2,00	2,00	3,00	2,00
Turn around time del test per Streptococcus pneumoniae (dall'inoculo della card al risultato strumentale)	1,96	2,00	2,00	3,00	3,00
Turn around time del test per Streptococcus pyogenes (dall'inoculo della card al risultato strumentale)	2,38	3,00	1,50	1,00	3,00
Turn around time del test per Plasmodium falciparum/vivax (dall'inoculo della card al risultato strumentale)	1,88	1,50	1,00	3,00	2,00

Criteria Tabellari

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	Punteggio DASIT S.p.A	Punteggio MASCIA BRUNELLI S.p.A	Punteggio Quidel Italy Srl	Punteggio Relab
Mini-strumento da bancone per lettura card	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Possibilità di usare lo strumento sia per la lettura che per l'incubazione	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Letture automatica della card al termine dell'incubazione	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Capacità del test di rilevare sierotipi di Legionella ulteriori, rispetto al sierotipo 1.	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
No necessità di centrifugazione / concentrazione del tes per Legionella	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Capacità del malaria test di identificare P.falciparum rispetto ad altre specie plasmodiali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Capacità del malaria test di identificare altre specie plasmodiali, oltre P.falciparum	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Reagenti pronti all'uso	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Possibilità di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica al fine di valutare i seguenti aspetti:

**Offerta complessivamente presentata per questo lotto:**

- ✓ Dall'analisi della documentazione ciascun commissario valuta buono il progetto presentato dalla Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL rispetto alle esigenze del laboratorio Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).

Dall'analisi della documentazione ciascun commissario valuta ottimo il progetto presentato dalla Società DASIT Spa rispetto alle esigenze del laboratorio, La strumentazione offerta permette, grazie alla sua automazione, semplicità, tecnologia e compattezza, ottimizza la possibilità di lavorare in maniera agevolata in un contesto di staff ridotto. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

- ✓ Dall'analisi della documentazione ciascun commissario valuta adeguato il progetto presentato dalla Società MASCIA BRUNELLI Spa rispetto alle esigenze del laboratorio Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,60).
- ✓ Dall'analisi della documentazione ciascun commissario valuta buono il progetto presentato dalla Società QUIDEL ITALY Srl rispetto alle esigenze del laboratorio Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).
- ✓ Dall'analisi della documentazione ciascun commissario valuta buono il progetto presentato dalla Società RELAB Srl rispetto alle esigenze del laboratorio Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).

Progetto di formazione:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che la Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL offre un'assistenza operativa di ottimo livello che, oltre ad un training iniziale approfondito e accurato, è ripetuta nel corso della durata del contratto su richiesta del personale e in corrispondenza del rilascio di aggiornamenti. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che la Società DASIT S.p.A offre un'assistenza operativa di ottimo livello che, oltre ad un training iniziale approfondito e accurato, è ripetuta nel corso della durata del contratto su richiesta del personale e in occasione del rilascio di aggiornamenti tecnologici. Giudizio attribuito da ciascun Commissari: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che il livello dell'offerta formativa presentata dalla MASCIA BRUNELLI S.p.A risulta adeguato alle rispetto alle esigenze del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,60).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che il livello dell'offerta formativa presentata dalla Quidel Italy Srl risulta adeguato alle esigenze del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,60).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che il livello dell'offerta formativa presentata dalla Relab Srl risulta buono rispetto alle esigenze del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Ciascun Commissario valuta la proposta dalla ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL adeguata. L'affiancamento prevede quindi la simulazione di test/routine in presenza di personale tecnico e laureato e un programma di tutoring per l'avviamento della routine, ovvero affiancamento da parte di



Sales Scientific Liaison fino all'acquisizione di una completa padronanza dello strumento da parte degli operatori. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: adeguato (0,60).

- ✓ Ciascun Commissario valuta la proposta dalla DASIT buona. Viene riportato il Curriculum di un collaboratore il quale possiede una buona formazione ed esperienza nel settore Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).
- ✓ Ciascun Commissario valuta la proposta dalla MASCIA BRUNELLI sufficiente. Viene riportato il nominativo di un collaboratore senza indicare il livello di formazione ed esperienza nel settore Giudizio attribuito da ciascun Commissario: sufficiente (0,20).
- ✓ Ciascun Commissario valuta la proposta dalla QUIDEL ITALY Srl adeguata. La società propone personale dipendente laureato in discipline scientifiche e adeguatamente formato. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).
- ✓ Ciascun Commissario valuta la proposta dalla RELAB ottima per la presenza di tre specialist di cui vengono allegati i relativi curricula. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Sostenibilità ambientale:

- ✓ La Commissione giudica la documentazione prodotta dalla Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL pienamente confacente alle aspettative del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ La Commissione giudica la documentazione prodotta dalla Società DASIT S.p.A pienamente confacente alle aspettative del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ La Commissione giudica la documentazione prodotta dalla Società MASCIA BRUNELLI S.p.A discreta, in particolare dichiarare di prediligere fornitori certificati ISO 9001:2005 e 14001 Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO (0,40).
- ✓ La Commissione giudica la documentazione prodotta dalla Società Quidel Italy Srl pienamente confacente alle aspettative del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ La Commissione giudica la documentazione prodotta dalla Società Relab pienamente confacente alle aspettative del laboratorio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	Punteggio DASIT S.p.A	Punteggio MASCIA BRUNELLI Sp.A	Punteggio Quidel Italy Srl	Punteggio Relab
Offerta complessivamente presentata per questo lotto	3,20	4,00	2,40	3,20	3,20
Progetto di formazione	3,00	3,00	1,80	1,80	2,40
Supporto specialistico offerto	1,20	1,60	0,40	1,20	2,00
Sostenibilità ambientale	2,00	2,00	0,80	2,00	2,00

mf

OS

SC

La Commissione pertanto assegna il punteggio tecnico totale alle Società partecipanti al lotto n. 14, in particolare:

Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 25,79 + 22,00 + 9,40 = 57,19

Società DASIT S.p.A

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 28,59 + 22,00 + 10,60 = 61,19

Società MASCIA BRUNELLI S.p.A

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 23,32 + 11,00 + 5,40 = 39,72

Società Quidel Italy Srl

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 28,47 + 24,00 + 8,20 = 60,67

Società Relab

Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 29,73 + 22,00 + 9,60 = 61,33

Terminata la valutazione del Lotto n. 14, la Commissione prosegue i lavori con la disamina tecnica del lotto n. 17 relativo alla fornitura di un "Sistema per determinazioni microbiologiche urgenti in biologia molecolare (multi target)"

Si procede pertanto ad esaminare la documentazione presentata dalla Società BioMérieux Italia SPA, unica offerente del presente lotto, valutando la conformità a quanto specificato nel Disciplinare.

La Commissione riscontra che l'offerta presentata dalla suindicata Società risponde ai requisiti minimi richiesti. Successivamente, si procede con la rilevazione dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8.

Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti dalla Società BioMérieux Italia SPA, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato.

Criteri Quantitativi

Criterio di valutazione	Punteggio Società BioMérieux Italia SPA
Ridotta rumorosità della strumentazione offerta	2,00
Tempo/operatore dedicato nel workflow dell'inserimento di un esame (ovvero di un singolo parametro per un singolo paziente)	3,00
Tempo/operatore dedicato alla manutenzione giornaliera	3,00

Criteri Tabellari

Criterio di valutazione	Punteggio Società BioMérieux Italia SPA
Automazione completa delle fasi di trattamento del campione, estrazione, purificazione degli acidi nucleici, amplificazione e rilevazione	2,00
Reattivi pronti all'uso o comunque di immediata ricostituzione	2,00
Presenza di controlli di processo e di amplificazione	2,00

(Handwritten signatures and initials)

Criterio di valutazione	Punteggio Società BioMérieux Italia SPA
Manualità limitata allo startup strumentale e all'inoculo del campione	2,00
Tempo di lavorazione del campione di liquor – cioè del tempo necessario a fornire un risultato completo dopo l'inoculo del campione – non superiore a 70 minuti	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di Escherichia coli K1	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di Haemophilus influenzae	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di Listeria monocytogenes	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di Neisseria meningitidis	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di Streptococcus agalactiae	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di Streptococcus pneumoniae	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di CMV	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di CMV	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di Enterovirus	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di HSV 2	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di HSV 6	1,00
Rilevamento nel campione di liquor di Human parechovirus	1,00
Rilevamento nel campione di liquor di VZV	2,00
Rilevamento nel campione di liquor di Cryptococcus neoformans	1,00
Analizzatore da bancone	3,00
Assistenza e manutenzione strumentale da remoto	4,00
Estensione al sabato e giorni festivi dei termini di capitolato per il ripristino della totale funzionalità della macchina	0,00
Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema	0,00
Possibilità di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati	2,00
Sistema di tracciamento degli ordini di kit e materiali fruibile dall'utilizzatore	2,00

mf *Q* *J* *Q*

La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica al fine di valutare i seguenti aspetti:

Offerta complessivamente presentata per questo lotto:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che il progetto proposto dalla Società BioMérieux Italia SPA è ottimamente strutturato e confacente alle esigenze del servizio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Progetto di formazione:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che il piano di formazione presentato si rileva adeguato alle esigenze. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,60).

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Dalla disamina dei Curricula presentati e dalle risorse bibliografiche ciascun Commissario verifica che l'offerta presentata dalla BioMérieux Italia SPA. è adeguata alle esigenze. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,60).

Sostenibilità ambientale:

- ✓ Ciascun Commissario giudica che l'offerente presenta un buon livello di sensibilizzazione. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).

Criterio di valutazione	Punteggio BioMérieux Italia SPA
Modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto	4,00
Progetto di formazione	1,80
Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web)	1,20
Sostenibilità ambientale	1,60

La Commissione pertanto assegna il punteggio tecnico totale alla Società BioMérieux Italia SPA, unico offerente per il Lotto n. 17, e in particolare:

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 8,00 + 46,00 + 8,60 = 62,60$$



Terminata la valutazione del Lotto n. 17, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dott.ssa Maria Letizia Schiavone

COMPONENTE Dott.ssa Annunziata Tamburro

COMPONENTE Ing. Mariasole Giacommo




Procedura aperta telematica in ambito comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura per 60 mesi in service di "sistemi macchina reagenti occorrenti al laboratorio di microbiologia"

Verbale n. 10 seduta riservata

19/02/2021

Dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Il giorno 19/02/2021 alle ore 09:30, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL Roma 1 si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 677 del 04/08/2020, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 325 del 14/04/2020, modificata con Deliberazione n. 400 del 20/05/2020.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE	Dott.ssa Maria Letizia Schiavone	Dirigente Biologo UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Dott.ssa Annunziata Tamburro	Coordinatore Tecnico UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Ing. Mariasole Giacommo	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9, continua con la disamina tecnica.

La Commissione riprende i lavori iniziando la disamina tecnica del lotto n. 5 relativo alla fornitura di un "Sistema automatico per la rilevazione di HCV-RNA, HBV-DNA, HIV-RNA".

Preliminarmente, si prende visione delle specifiche tecniche a pena esclusione contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato 3.1 per quanto concerne il lotto in esame.

Si procede pertanto ad esaminare la documentazione presentata dalle sotto indicate Società offerenti, valutando la conformità a quanto specificato nel Disciplinare:

- ABBOTT S.r.l
- ELITECHGROUP S.P.A
- HOLOGIC ITALIA S.r.l
- QIAGEN S.r.l
- ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A

Durante la disamina delle caratteristiche tecniche minime, con particolare riferimento all'offerta tecnica presentata dalla Società ELITECHGROUP S.P.A, la Commissione ritiene necessario richiedere un chiarimento in relazione al numero complessivo di strumenti offerti, al fine di accertarsi della rispondenza alle specifiche indicate da Capitolato tecnico.

La Commissione procede pertanto alla formulazione della seguente richieste di chiarimento alla Società ELITECHGROUP S.P.A:

- "In merito al lotto 5, si chiede di confermare il numero complessivo di mini centrifughe e vortex offerti".

La Commissione riscontra che sono rispettati gli altri requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico da parte di tutte le Società presentanti offerta per il lotto n. 5 e rimanda a successiva seduta riservata la disamina dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8, in attesa di riscontro al su indicato chiarimento da parte della ELITECHGROUP S.P.A.

La Commissione prosegue i lavori con la disamina tecnica del lotto n. 19 relativo alla fornitura di un "Sistema per ricerche immunochimiche (diagnostica non infettivologica)".

Preliminarmente, si prende visione delle specifiche tecniche a pena esclusione contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato 3.1 per quanto concerne il lotto in esame.

Si procede pertanto ad esaminare la documentazione presentata dalle sotto indicate Società offerenti, valutando la conformità a quanto specificato nel Disciplinare:

- Dasit S.p.a.
- MEDICAL SYSTEMS

La Commissione riscontra che le offerte presentate dalle suindicate società partecipanti sono rispondenti ai requisiti minimi richiesti.

Successivamente, si procede con la rilevazione dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8. Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti dalle società DASIT Spa e MEDICAL SYSTEMS, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato.

Criteri Quantitativi

Criterio di valutazione	Punteggio Dasit S.p.a.	Punteggio MEDICAL SYSTEMS
Sensibilità analitica per riferimento 1	0,90	3,00
Range di linearità della metodica (riferimento 1)	3,00	0,90
Sensibilità analitica per riferimento 2	0,00	3,00
Range di linearità della metodica (riferimento 2)	0,00	3,00
Ridotta rumorosità della strumentazione offerta	2,00	1,93
Tempo/operatore dedicato nel workflow dell'inserimento di un esame (ovvero di un singolo parametro per un singolo paziente)	2,85	3,00
Tempo/operatore dedicato alla manutenzione giornaliera	3,00	3,00

In relazione ai criteri "Sensibilità analitica per riferimento 1" e "Sensibilità analitica per riferimento 2" la Commissione rileva l'inesattezza della formula di attribuzione del punteggio presente nell'Allegato 8 al Disciplinare di gara (lesimo/Massimo) e stabilisce di utilizzare la formula Minimo/lesimo al fine di premiare il valore di sensibilità analitica maggiormente performante.


Criteria Tabellari

Criterio di valutazione	Punteggio Dasit S.p.a.	Punteggio MEDICAL SYSTEMS
Reagenti pronti all'uso	3,00	3,00
Lavorazione diretta su contenitore di raccolta	2,00	2,00
Identificazione del contenitore di raccolta con barcode	2,00	2,00
Caricamento in continuo dei campioni	2,00	2,00
Possibilità di inserire campioni in modalità STAT	0,00	2,00
Strumentazione da bancone	2,00	2,00
Assistenza e manutenzione strumentale da remoto	4,00	4,00
Estensione al sabato e giorni festivi dei termini di capitolato per il ripristino della totale funzionalità della macchina.	2,00	2,00
Completezza dei riferimenti del lotto	0,00	4,00
Esecuzione dei due riferimenti su un'unica strumentazione	0,00	2,00
Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema	2,00	2,00
Restituzione di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati	2,00	2,00
Scarico automatico reagenti e/o cartucce	2,00	0,00
Sistema di tracciamento degli ordini di kit e materiali fruibile dall'utilizzatore	2,00	2,00

La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica al fine di valutare i seguenti aspetti:

Modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che l'offerta presentata dalla Società Dasit S.p.a. risponde ottimamente alle esigenze del laboratorio- Le modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto risultano ottimamente illustrate nei dettagli. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che l'offerta presentata dalla Società MEDICAL SYSTEMS risponde ottimamente alle esigenze del laboratorio- Le modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto risultano ottimamente illustrate nei dettagli. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

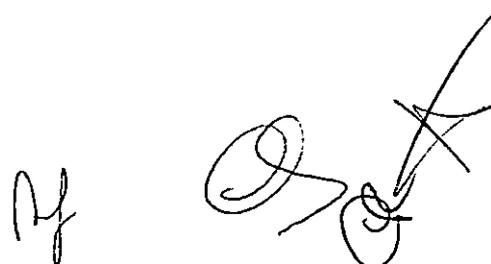

Ergonomia del sistema:

- ✓ Ciascun Commissario valuta l'ergonomia del sistema offerto della società Dasit Spa ottima rispetto agli spazi assegnati. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta l'ergonomia del sistema offerto della società MEDICAL SYSTEMS ottima rispetto agli spazi assegnati. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Middleware strumentale:

- ✓ Ciascun Commissario valuta il software fornito dalla Società Dasit S.p.a. ottimamente adeguato alle esigenze. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario giudica che il software fornito dalla Società MEDICAL SYSTEMS ottimamente adeguato alle esigenze. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Progetto di formazione:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che il progetto di formazione offerto dalla Società Dasit S.p.a. è ottimamente descritto ed illustrato. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che il progetto di formazione offerto dalla Società MEDICAL SYSTEMS. è ottimamente descritto ed illustrato. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Ciascun Commissario verifica che il supporto specialistico della Società Dasit S.p.a. è perfettamente adeguato alle esigenze. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che il supporto specialistico della Società MEDICAL SYSTEMS è perfettamente adeguato alle esigenze. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Sostenibilità ambientale:

- ✓ Ciascun Commissario valuta ottime le misure attuate dalla Società Dasit S.p.a in merito alla sostenibilità ambientale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta ottime le misure attuate dalla Società MEDICAL SYSTEMS in merito alla sostenibilità ambientale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

criterio di valutazione	Punteggio Dasit Sp.a	Punteggio MEDICAL SYSTEMS
Modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto	5,00	5,00
Ergonomia del sistema	2,00	2,00
Middleware strumentale (fornire descrizione)	3,00	3,00
Progetto di formazione	3,00	3,00
Supporto specialistico offerto	2,00	2,00

mf *ASL*



Sostenibilità ambientale	2,00	2,00
--------------------------	------	------

La Commissione pertanto assegna il punteggio tecnico totale alle Società partecipanti al lotto n. 19, in particolare:

Società Dasit S.p.a.

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 11,75 + 25,00 + 17,00 = 53,75$$

Società MEDICAL SYSTEMS

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 17,83 + 31,00 + 17,00 = 65,83$$

Terminata la valutazione del Lotto n. 19, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dott.ssa Maria Letizia Schiavone

COMPONENTE Dott.ssa Annunziata Tamburro

COMPONENTE Ing. Mariasole Giacummo

Procedura aperta telematica in ambito comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura per 60 mesi in service di "sistemi macchina reagenti occorrenti al laboratorio di microbiologia"

Verbale n. 11 seduta riservata

26/02/2021

Dalle ore 09:30 alle ore 10:30

Il giorno 26/02/2021 alle ore 09:30, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL Roma 1 si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 677 del 04/08/2020, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 325 del 14/04/2020, modificata con Deliberazione n. 400 del 20/05/2020.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE	Dott.ssa Maria Letizia Schiavone	Dirigente Biologo UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Dott.ssa Annunziata Tamburro	Coordinatore Tecnico UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Ing. Mariasole Giacummo	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 continua con la disamina tecnica.

La Commissione riprende i lavori continuando la disamina tecnica del lotto n. 5 relativo alla fornitura di un "Sistema automatico per la rilevazione di HCV-RNA, HBV-DNA, HIV-RNA".

La Commissione procede alla lettura del chiarimento trasmesso dalla Società ELITECHGROUP S.P.A:

- "Si conferma quanto offerta e presentato nella ns offerta economica: n° 2 MiniCentrifughe/Vortex FVL-2400N Combispin e FV-2400 Microspin".



La Commissione rileva altresì che la Società ELITECHGROUP S.P.A ha allegato inopportuna, a comprova della strumentazione offerta, la propria offerta economica.

La Commissione ritiene necessario riferire al RUP della procedura quanto rilevato mediante opportuna comunicazione (Allegato 1) e stabilisce, in attesa di decisioni in merito alla posizione dell'operatore predetto, di sospendere la valutazione delle offerte tecniche presentate per il Lotto n. 5.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 10:30.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE	Dott.ssa Maria Letizia Schiavone
COMPONENTE	Dott.ssa Annunziata Tamburro
COMPONENTE	Ing. Mariasole Giacummo



Roma, 01/03/2021

Al Rup della procedura
 Dott. Vittorio Santoriello

Oggetto: procedura aperta in modalità telematica indetta per la fornitura per 60 mesi in service suddivisa in 19 Lotti di sistemi macchine reagenti occorrenti al Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Ospedale San Filippo Neri, e per le linee di attività correlate, ai Laboratori del sistema HUB/SPOKE 3 della Regione Lazio.

Nel premettere che la Commissione, nominata con Deliberazione n. 677/2020, sta ultimando i lavori di valutazione della documentazione tecnica presentata dagli operatori partecipanti alla iniziativa di gara richiamata in oggetto, si comunica che, a fronte di una richiesta di chiarimenti inoltrata a mezzo sistema telematico in data 16/02/2021 in merito al Lotto 5 - *Sistema automatico per la rilevazione di HCV-RNA, HBV-DNA, HIV-RNA* - e specificamente sul numero complessivo di minicentrifughe e vortex offerti, l'operatore ELITECHGROUP Spa ha fornito nella stessa data riscontro, allegando, a comprova della strumentazione offerta, inopportunitamente, la propria offerta economica.

Detto quanto sopra, si rimane in attesa delle determinazioni che la S.V. vorrà adottare in merito alla posizione dell'operatore in trattazione.

Cordiali saluti.

I Componenti della Commissione

Il Presidente della Commissione:



Dott.ssa Maria Letizia Schiavone


Il Membro della Commissione:

Dott. Annunziata Tamburro

Il Membro della Commissione:

Ing. Maria Sole Giacommo

Procedura aperta telematica in ambito comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura per 60 mesi in service di "sistemi macchina reagenti occorrenti al laboratorio di microbiologia"

Verbale n. 12 seduta riservata

14/04/2021

Dalle ore 09:30 alle ore 10:30

Il giorno 14/04/2021 alle ore 09:30, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL Roma 1 si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 677 del 04/08/2020, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 325 del 14/04/2020, modificata con Deliberazione n. 400 del 20/05/2020.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE	Dott.ssa Maria Letizia Schiavone	Dirigente Biologo UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Dott.ssa Annunziata Tamburro	Coordinatore Tecnico UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Ing. Mariasole Giacummo	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, 11 e continua con la disamina tecnica.

La Commissione riprende i lavori, prendendo atto dei chiarimenti fatti pervenire dall'operatore EUROSPITAL Spa in merito al criterio quantitativo "Tempo/operatore dedicato nel workflow dell'inserimento di un singolo test". L'operatore rappresenta che il "tempo/operatore dedicato nel workflow all'inserimento di un singolo test" è pari a circa 10 secondi e che il valore riportato in scheda tecnica di riferimento si riferisce, come già dichiarato nella documentazione tecnica presentata, a tutta le operazioni manuali necessarie a preparare l'intera seduta.

Alla luce di quanto dichiarato, la Commissione procede alla attribuzione dei criteri di valutazione quantitativi e, di conseguenza, alla definizione dei punteggi tecnici totali del lotto n. 8.

Criteri Quantitativi

Criterio di valutazione	Punteggio DiaSort S.p.A.	Punteggio EFFEGIEMME	Punteggio Eurospital S.p.A.
Stabilità calibrazione	4,00	0,00	0,20
Tempo/operatore dedicato nel workflow dell'inserimento di un singolo test	0,17	1,50	3,00

In relazione al criterio "Stabilità calibrazione", la Società EFFEGIEMME indica che il sistema proposto è autocalibrante non specificando tuttavia la durata della stabilità. Per tale motivazione, la Commissione decide di attribuire un punteggio pari a 0 non disponendo sufficienti informazioni per quantificare il punteggio.

La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico totale alle Società partecipanti al lotto n. 8, in particolare:

Società Diasorin S.p.A.

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 4,50 + 45,00 + 15,00 = 64,50$$

Società Effegiemme S.r.l

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 1,50 + 44,00 + 2,40 = 47,90$$

Società Eurospital S.p.A.

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 3,20 + 34,00 + 7,00 = 44,20$$

Terminata la valutazione del Lotto n. 8, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 10:30.


Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dott.ssa Maria Letizia Schiavone

COMPONENTE Dott.ssa Annunziata Tamburro

COMPONENTE Ing. Mariasole Giacommo







Procedura aperta telematica in ambito comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura per 60 mesi in service di "sistemi macchina reagenti occorrenti al laboratorio di microbiologia"

**Verbale n. 13 seduta riservata
07/05/2021
Dalle ore 09:30 alle ore 13:00**

Il giorno 07/05/2021 alle ore 09:30, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL Roma 1 si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 677 del 04/08/2020, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 325 del 14/04/2020, modificata con Deliberazione n. 400 del 20/05/2020.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE	Dott.ssa Maria Letizia Schiavone	Dirigente Biologo UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Dott.ssa Annunziata Tamburro	Coordinatore Tecnico UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Ing. Mariasole Giacommo	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12 e continua con la disamina tecnica.

La Commissione riprende i lavori riprendendo la disamina tecnica del lotto n. 9 relativo a "Reagenti per ricerche antigeniche rapide su feci", rappresentando che l'operatore Record Separation non ha confermato la validità della propria offerta e pertanto si prenderanno in considerazione le seguenti offerte:

- ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
- D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA
- MASCIA BRUNELLI S.p.A
- MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL


La Commissione riscontra che le offerte presentate dalle suindicate società partecipanti sono rispondenti ai requisiti minimi richiesti.

Successivamente, si procede con la rilevazione dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8.

Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti dalle società sopramenzionate, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato.

Criteri Quantitativi

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	Punteggio D.I.D. SPA	Punteggio MASCIA BRUNELLI S.p.A	Punteggio Meridian Bioscience Europe Srl
Grado di completezza dei riferimenti del lotto	5,00	4,50	5,00	5,00
Sensibilità analitica per Rotavirus Ag	1,98	1,94	1,98	2,00
Sensibilità analitica per Adenovirus Ag	1,98	1,90	1,98	2,00
Sensibilità analitica per Norovirus Ag	1,82	2,00	1,98	2,00

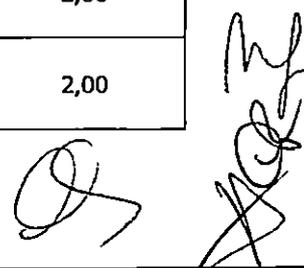



Sensibilità analitica per Clostridium difficile Ag comune (GDH)	1,62	2,00	2,00	2,00
Sensibilità analitica per Clostridium difficile tossina A	1,78	2,00	2,00	2,00
Sensibilità analitica per Clostridium difficile tossina B	1,78	2,00	2,00	2,00
Turnaround Time del test per Cdiff GDH (dall'inoculo del supporto alla lettura)	1,60	4,00	4,00	4,00
Turnaround Time del test per Cdiff tossine (dall'inoculo del supporto alla lettura)	1,60	4,00	4,00	2,68
Sensibilità analitica per Helicobacter pylori Ag (HPSA)	1,80	1,96	1,98	2,00
Sensibilità analitica per Cryptosporidium parvum Ag	2,00	1,96	2,00	2,00
Sensibilità analitica per Giardia spp. Ag	1,96	1,90	2,00	2,00
Sensibilità analitica per Entamoeba histolytica	2,00	1,94	0,00	2,00
Sensibilità analitica per Entamoeba histolytica o dispar Ag	2,00	1,94	1,98	2,00
Sensibilità analitica per ricerca diretta E. coli O157:H7	1,98	1,98	2,00	0,00
Sensibilità analitica per altre tossine Shiga direttamente nelle feci	2,00	0,00	0,00	0,00
Sensibilità analitica per altre tossine Shiga dopo coltura	2,00	0,00	0,00	1,74

Criteri Tabellari

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	Punteggio D.I.D. S.P.A.	Punteggio MASGA BRUNELUS P.A.	Punteggio Meridian Bioscience Europe Srl
Formulazione come "monotest"	4,00	4,00	4,00	4,00
Metodo immunocromatografico rapido	4,00	4,00	4,00	4,00
Capacità di identificare Entamoeba histolytica	2,00	2,00	0,00	2,00
Capacità di identificare E. coli O157:H7 direttamente nelle feci	2,00	2,00	2,00	0,00

Capacità di rilevare altre tossine Shiga direttamente nelle feci	2,00	0,00	2,00	0,00
Capacità di rilevare tossine Shiga dopo coltura	2,00	0,00	2,00	2,00
Restituzione di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati	2,00	2,00	2,00	2,00

La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica al fine di valutare i seguenti aspetti:

Offerta complessivamente presentata:

- ✓ Ciascun Commissario verifica che l'offerta presentata dalla Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL rispecchia ottimamente le esigenze per quanto concerne le modalità di agevolazione della raccolta di analiti, nonché per la riduzione delle manipolazioni e l'igiene associata a queste. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che l'offerta presentata dalla Società D.I.D. S.P.A è ottimamente rispondente alle esigenze per quanto concerne le modalità di agevolazione della raccolta di analiti, nonché per la riduzione delle manipolazioni e l'igiene associata a queste. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta l'offerta della ditta MASCIA BRUNELLI S.p.A ben appropriata in relazione alle esigenze del laboratorio Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO (0,80).
- ✓ Ciascun Commissario verifica che l'offerta presentata dalla Società Meridian Bioscience Europe Srl rispecchia ottimamente le esigenze per quanto concerne le modalità di agevolazione della raccolta di analiti, nonché per la riduzione delle manipolazioni e l'igiene associata a queste. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Qualità e consistenza del percorso formativo offerto:

- ✓ Ciascun Commissario valuta il progetto formativo elaborato dalla Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL ottimamente corrispondente alle esigenze per gli aspetti di raggiungimento dell'autonomia, di mantenimento e di continuità di aggiornamento delle competenze del personale utilizzatore. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta il progetto formativo elaborato dalla Società D.I.D. S.P.A ottimamente corrispondente alle esigenze per gli aspetti di raggiungimento dell'autonomia, del mantenimento e della continuità di aggiornamento delle competenze del personale utilizzatore. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta il progetto formativo elaborato dalla società MASCIA BRUNELLI S.p.A il sufficiente rispetto alle esigenze per gli aspetti di raggiungimento dell'autonomia, del mantenimento e della continuità di aggiornamento delle competenze del personale utilizzatore. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE (0,20).
- ✓ Ciascun Commissario giudica il progetto formativo elaborato dalla Società Meridian Bioscience Europe Srl ottimamente corrispondente alle esigenze per gli aspetti di raggiungimento dell'autonomia e al

(Handwritten signatures and initials)

mantenimento e continuità di aggiornamento delle competenze del personale utilizzatore. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che le competenze degli specialist proposta dalla Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL risultano ottimamente approfondite. Per quanto attiene alle risorse bibliografiche messe a disposizione degli operatori, i Commissari valutano la proposta offerta perfettamente in linea alle esigenze del servizio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che le competenze degli specialist proposta dalla Società D.I.D. S.P.A risulta ottimamente approfondita, anche per quanto attiene alle risorse bibliografiche messe a disposizione degli operatori. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Commissario valuta che la ditta MASCIA BRUNELLI S.p.A offre un supporto specialistico sufficiente in relazione alle esigenze del servizio operatori. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE (0,20).
- ✓ Ciascun Commissario evidenzia che le competenze degli specialist proposta dalla Meridian Bioscience Europe Srl risultano estremamente approfondite. Per quanto attiene alle risorse bibliografiche messe a disposizione degli operatori, i Commissari valutano la proposta offerta perfettamente in linea alle esigenze del servizio. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).

Sostenibilità ambientale:

- ✓ la Commissione evidenzia che la Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL presenta un ottimo livello di sostenibilità ambientale, attraverso l'attuazione di politiche atte alla riduzione degli scarti prodotti dai campioni. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ la Commissione evidenzia che la Società D.I.D. S.P.A presenta un ottimo livello di sostenibilità ambientale, attraverso l'attuazione di politiche atte alla riduzione degli scarti prodotti dai campioni. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO (1,00).
- ✓ la Commissione valuta un adeguato livello di sostenibilità ambientale della Società MASCIA BRUNELLI S.p.A, che dichiara in particolare predilige fornitori certificati ISO 9001:2005 e 14001. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: ADEGUATO (0,40).

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	Punteggio D.I.D. S.P.A	Punteggio MASCIA BRUNELLI S.p.A	Punteggio Meridian Bioscience Europe Srl
Offerta complessivamente presentata per questo lotto	4,00	4,00	3,20	4,00
Qualità e consistenza del percorso formativo offerto	3,00	3,00	0,60	3,00
Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse)	2,00	2,00	0,40	2,00

Mf

Q

P

bibliografiche su web)				
Sostenibilità ambientale	2,00	2,00	0,80	2,00

La Commissione pertanto assegna il punteggio tecnico totale alle Società partecipanti al lotto n. 9, in particolare:

Società ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL

$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 34,90 + 18,00 + 11,00 = 63,90$

Società D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA

$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 36,02 + 14,00 + 11,00 = 61,02$

Società MASCIA BRUNELLI S.p.A

$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 34,90 + 16,00 + 5,00 = 55,90$


Società Meridian Bioscience Europe Srl

$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 35,42 + 14,00 + 11,00 = 60,42$


Terminata la valutazione del Lotto n. 9, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 12:30.

Letto, confermato e sottoscritto


PRESIDENTE Dott.ssa Maria Letizia Schiavone



COMPONENTE Dott.ssa Annunziata Tamburro



COMPONENTE Ing. Mariasole Giacommo



Procedura aperta telematica in ambito comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura per 60 mesi in service di "sistemi macchina reagenti occorrenti al laboratorio di microbiologia"

Verbale n. 14 seduta riservata

13/05/2021

Dalle ore 09:30 alle ore 12:30

Il giorno 13/05/2021 alle ore 09:30, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL Roma 1 si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 677 del 04/08/2020, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 325 del 14/04/2020, modificata con Deliberazione n. 400 del 20/05/2020.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE	Dott.ssa Maria Letizia Schiavone	Dirigente Biologo UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Dott.ssa Annunziata Tamburro	Coordinatore Tecnico UOC Microbiologia e Virologia
COMPONENTE	Ing. Mariasole Giacummo	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 e continua con la disamina tecnica.

La Commissione riprende i lavori continuando la disamina tecnica del lotto n. 5 relativo alla fornitura di un "Sistema automatico per la rilevazione di HCV-RNA, HBV-DNA, HIV-RNA".

La Commissione prende atto della decisione del RUP della procedura in merito all'esclusione dell'operatore Società ELITECHGROUP S.P.A dal presente lotto, secondo disposizione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e di quanto riportato nella sez. 22 del Disciplinare di gara, come da Determinazione n. 484 del 03/03/2021.

La Commissione pertanto procede alla rilevazione dei parametri di valutazione di cui all'Allegato 8 per le seguenti Società offerenti:

- ABBOTT S.r.l
- HOLOGIC ITALIA S.r.l
- QIAGEN S.r.l
- ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A

Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti dalle suindicate società, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato.



Criteri Quantitativi

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT Srl	Punteggio HOLOGIC ITALIA Srl	Punteggio QIAGEN Srl	Punteggio ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A
Sensibilità analitica test HBV	0,51	1,03	1,19	2,00
Sensibilità analitica test HcC	0,68	2,00	1,09	0,91
Sensibilità analitica test HIV	0,89	1,48	2,00	1,35
Ridotta rumorosità della strumentazione offerta	1,63	1,86	1,53	2,00
Tempo/operatore dedicato nel workflow dell'inserimento di un esame (ovvero di un singolo parametro per un singolo paziente)	3,00	0,30	0,30	0,60
Tempo/operatore dedicato nel workflow della refertazione di un esame (ovvero di un singolo parametro per un singolo paziente)	2,00	2,00	0,02	2,00
Tempo/operatore dedicato alla manutenzione giornaliera	3,00	3,00	0,02	3,00

Criteri Tabellari

Criterio di valutazione	Punteggio ABBOTT Srl	Punteggio HOLOGIC ITALIA Srl	Punteggio QIAGEN Srl	Punteggio ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A
Tecnologia utilizzata	2,00	0,00	2,00	2,00
Modalità di lavoro walk away	2,00	2,00	2,00	2,00
Reagenti pronti all'uso	2,00	0,00	2,00	2,00
Possibilità di eseguire in urgenza tutte le tipologie di esami indicati	2,00	2,00	2,00	2,00
Lavorazione su tubo primario	3,00	3,00	3,00	3,00
Sistema di identificazione reagenti con barcode	2,00	2,00	2,00	2,00
Sistema di prevenzione delle contaminazioni ambientali del campione	3,00	0,00	3,00	3,00
Lavorazione random access	2,00	2,00	2,00	2,00

M O A

Capacità di lavorare più parametri simultaneamente	2,00	2,00	2,00	2,00
Capacità di inserire campioni in urgenza	2,00	2,00	2,00	2,00
Software in grado di gestire i controlli interni e il QC esterno di terza parte	2,00	2,00	2,00	2,00
Assistenza e manutenzione strumentale da remoto	4,00	4,00	4,00	4,00
Estensione al sabato e giorni festivi dei termini di capitolato per il ripristino della totale funzionalità della macchina	2,00	2,00	2,00	2,00
Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema	3,00	3,00	0,00	3,00
Possibilità di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati	3,00	3,00	3,00	3,00
Presenza di sistema di tracciamento degli ordini di kit e materiali fruibile dall'utilizzatore	3,00	3,00	3,00	3,00

La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica al fine di valutare i seguenti aspetti:

Modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto:

- ✓ Ciascun Componente valuta le modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto dalla Società ABBOTT S.r.l discrete. L'operatore rappresenta che l'operazione di consegna ed installazione avverranno entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo diverso accordo scritto con l'Asl Roma 1. Giudizio attribuito da ciascun Componente: DISCRETO (0,40).
- ✓ Ciascun Componente valuta le modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto dalla Società HOLOGIC S.r.l discrete. L'operatore rappresenta che l'operazione di consegna ed installazione avverranno entro 50 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Giudizio attribuito da ciascun Componente: DISCRETO (0,40).
- ✓ Ciascun Componente valuta le modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto dalla Società QIAGEN S.r.l ottime. L'operatore garantisce tempi di transizione brevi, pari a sei giorni, riducendo al minimo i disagi per gli Operatori. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Componente valuta le modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto dalla Società ROCHE DIAGNOSTICS ottime. Il piano di transizione risulta ottimamente descritto ed è finalizzato a ridurre al minimo i disagi per gli Operatori. L'operatore si rende disponibile a ridefinire il progetto proposto in base alle esigenze specifiche della stazione appaltante. L'operatore fornisce altresì dettagliato cronoprogramma Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).

Mf *Q* *☆* *Q*

**Ergonomia del sistema: efficienza nell'utilizzo degli spazi assegnati:**

- ✓ Ciascun Componente valuta l'ergonomia del sistema offerto dalla Società ABBOTT S.r.l adeguata rispetto all'efficienza del sistema. Giudizio attribuito da ciascun Componente: ADEGUATO (0,60).
- ✓ Ciascun Componente valuta l'ergonomia del sistema offerto dalla Società Hologic adeguata rispetto all'efficienza del sistema. Giudizio attribuito da ciascun Componente: ADEGUATO (0,60).
- ✓ Ciascun Componente valuta l'ergonomia del sistema offerto dalla Società QIAGEN S.r.l adeguata rispetto all'efficienza del sistema. Giudizio attribuito da ciascun Componente: ADEGUATO (0,60).
- ✓ Ciascun Componente valuta l'ergonomia del sistema offerto dalla Società Roche Diagnostica ottimo rispetto all'efficienza del sistema. Gli ingombri della strumentazione sono ottimamente compensati dall'elevato walk-away, dall'alta produttività e dalla possibilità di stoccaggio di controlli, reagenti e plastiche direttamente a bordo della macchina, limitando in tal modo la necessità di utilizzo di frigoriferi e di altra strumentazione connessa alla fornitura. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).

Middleware strumentale:

- ✓ Ciascun Componente valuta il middleware strumentale offerto dalla ABBOTT ottimo. Il middleware risulta ottimamente descritto ed illustrato. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00)
- ✓ Ciascun Componente verifica che la società HOLOGIC ITALIA S.r.l non offre alcun middleware strumentale, in quanto è previsto l'interfacciamento diretto al LIS. Giudizio attribuito da ciascun Componente: INSUFFICIENTE (0,00).
- ✓ Ciascun Componente verifica che la società QIAGEN S.r.l offre un middleware strumentale, non fornendo alcuna indicazione sulle potenzialità/capacità del software. Giudizio attribuito da ciascun Componente: SUFFICIENTE (0,20).
- ✓ Ciascun Componente valuta il middleware strumentale offerto dalla ROCHE DIAGNOSTICS ottimo. Il middleware risulta ottimamente descritto ed illustrato. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00)

Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web):

- ✓ Ciascun Componente valuta il supporto specialistico offerto dalla Società ABBOTT S.r.l discreto. In particolare, il supporto è garantito da n. 1 specialist con esperienza decennale nel settore oggetto di gara di cui viene allegato il relativo curriculum. L'operatore presenta un discreto numero di dati scientifici. Giudizio attribuito da ciascun Componente: DISCRETO (0,40).
- ✓ Ciascun Componente valuta il supporto specialistico offerto dalla Società HOLOGIC S.r.l discreto. In particolare, il supporto è garantito da n. 4 specialist con esperienza nel settore oggetto di gara. L'operatore non presenta dati scientifici. Giudizio attribuito da ciascun Componente: DISCRETO (0,40).
- ✓ Ciascun Componente valuta il supporto specialistico offerto dalla Società QIAGEN S.r.l buono. In particolare, il supporto è garantito da n. 9 specialist con esperienza nel settore oggetto di gara. Giudizio attribuito da ciascun Componente: BUONO (0,80).

- ✓ Ciascun Componente valuta il supporto specialistico offerto dalla Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A ottimo. E' prevista specifica assistenza tramite numero verde, o in alternativa, mediante 12 linee telefoniche, gli specialisti sono divisi per linea strumentale e per competenze tecniche, applicative o di Information technology. Viene garantita la disponibilità di un portale dedicato on line per il reperimento di ogni informazione e servizio di interesse. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).

Soluzioni atte a ridurre il rischio legato allo smaltimento dei reflui e/o dei rifiuti in generale:

- ✓ Ciascun Componente verifica che lo strumento offerto dalla Società ABBOTT S.r.l dispone di 2 contenitori differenziati chiusi di capacità tali da garantire lo smaltimento di elevate quantità di rifiuti. La quantità di rifiuti prodotti dallo strumento è ridotta, minimizzando le operazioni di svuotamento dei contenitori. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Componente verifica che lo strumento offerto dalla Società HOLOGIC S.r.l prevede che tutti i rifiuti solidi e liquidi vengono convogliati in appositi contenitori posti all'interno di un vano del Panther tale da garantire adeguatamente lo smaltimento dei rifiuti prodotti. Giudizio attribuito da ciascun Componente: ADEGUATO (0,60).
- ✓ Ciascun Componente verifica che lo strumento offerto dalla Società QIAGEN S.r.l prevede un sacchetto per il contenimento del materiale di scarto che presenta caratteristiche tali da garantire un insieme di vantaggi in materia di sicurezza. Giudizio attribuito da ciascun Componente: BUONO (0,80).
- ✓ Ciascun Componente verifica che la strumentazione proposta dalla Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A è pienamente conforme alle esigenze, grazie all'elevata autonomia di processamento, inclusa la raccolta dei materiali di scarto, limitando drasticamente le operazioni di smaltimento dei rifiuti a carico dell'operatore e producendo altresì rifiuti solidi e liquidi in quantità minime. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).

Sostenibilità ambientale

- ✓ Ciascun Componente verifica che la perfetta corrispondenza alle richieste in materia di sostenibilità garantite dal sistema offerto dalla Società ABBOTT S.r.l. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Componente verifica che la perfetta corrispondenza alle richieste in materia di sostenibilità garantite dal sistema offerto dalla HOLOGIC ITALIA S.r.l. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Componente verifica che la perfetta corrispondenza alle richieste in materia di sostenibilità garantite dal sistema offerto dalla QIAGEN S.r.l. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).
- ✓ Ciascun Componente verifica che la perfetta corrispondenza alle richieste in materia di sostenibilità garantite dal sistema offerto dalla Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. Giudizio attribuito da ciascun Componente: OTTIMO (1,00).

Criterio di Valutazione	Punteggio/ABBOTT S.r.l	Punteggio/HOLOGIC ITALIA S.r.l	Punteggio/QIAGEN S.r.l	Punteggio/ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A
Modalità di gestione e di implementazione del sistema offerto	1,60	1,60	4,00	4,00

M O S

Ergonomia del sistema	1,20	1,20	1,20	2,00
Middleware strumentale	3,00	0,00	0,60	3,00
Supporto specialistico offerto (CV degli specialist e/o disponibilità di risorse bibliografiche su web)	0,80	0,80	1,60	2,00
Soluzioni atte a ridurre il rischio legato allo smaltimento dei reflui e/o dei rifiuti in generale	2,00	1,20	1,60	2,00
Sostenibilità ambientale	2,00	2,00	2,00	2,00

La Commissione pertanto assegna il punteggio tecnico totale alle Società partecipanti al lotto n. 5, in particolare:

Società ABBOTT S.r.l

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 11,71 + 39,00 + 10,60 = 61,31$$

Società HOLOGIC ITALIA S.r.l

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 11,67 + 32,00 + 6,80 = 50,47$$

Società QIAGEN S.r.l

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 6,14 + 36,00 + 11,00 = 53,14$$

Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A

$$P_{\text{tecnico}} = P_{\text{quantitativo}} + P_{\text{tabellare}} + P_{\text{discrezionale}} = 11,86 + 39,00 + 15,00 = 65,86$$

In merito al lotto n. 10, come da nota prot. n. 71062 del 03/05/2021 inviata dal Direttore del Dipartimento dei Laboratori, Dr. Meledandri, inviata alla Commissione in stessa data, non si provvederà alla valutazione del lotto sopra menzionato, per le ragioni indicate nella medesima nota (Allegato 1).

Terminata la valutazione dei Lotti della procedura di gara in oggetto, la Commissione dichiara terminati i lavori e procede all'inserimento dei punteggi di valutazione tecnica sul Sistema STELLA.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dott.ssa Maria Letizia Schiavone

COMPONENTE Dott.ssa Annunziata Tamburro

COMPONENTE Ing. Mariasole Giacommo

Maria Letizia Schiavone
Annunziata Tamburro
Mariasole Giacommo

OK



Oggetto: Procedura aperta telematica, in ambito comunitario, finalizzata all'affidamento per 60 mesi della fornitura in service di sistemi macchina reagenti occorrenti al laboratorio di Microbiologia e Virologia del S. Filippo Neri e, per le linee di attività correlate, ai laboratori del sistema HUB/SPOKE 3 Regione Lazio.

VERBALE seduta riservata: valutazione delle offerte economiche, attribuzione dei punteggi economici e della determinazione della graduatoria di gara

Premesso:

che, con Deliberazione n. 325 del 14/04/2020, è stata indetta, tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio, una gara, secondo le modalità della procedura aperta finalizzata all'affidamento per 60 mesi della fornitura in service di sistemi macchina reagenti occorrenti al laboratorio di microbiologia e virologia dell'Ospedale S. Filippo Neri e, per le linee di attività correlate, ai Laboratori del sistema HUB/SPOKE 3 Regione Lazio;

che, con Deliberazione n. 677 del 04/08/2020, è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte in merito alla gara in oggetto;

che, con Determina dirigenziale n. 1993 del 03/08/2020, tutti gli operatori aventi presentato offerta sono stati ammessi al proseguo della gara;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 484 del 03/03/2021, è stata formalizzata l'esclusione dell'operatore economico ELITECH GROUP dalla partecipazione alla gara in merito al Lotto 5;

che, in varie sedute riservate, la Commissione ha concluso la valutazione tecnica delle offerte;

che, nella seduta pubblica virtuale del 18/05/2021, la Commissione ha proceduto a dar conto dei punteggi qualità ed all'apertura delle offerte economiche, riservandosi di avviare in seduta riservata la valutazione delle offerte economiche;

oggi 04/06/2021 alle ore 9,00 circa, presso la UOC Ingegneria Clinica dell'ASL Roma I, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione per procedere alla valutazione delle offerte economiche, alla conseguente attribuzione dei punteggi economici ed infine alla determinazione della graduatoria di gara per ogni Lotto.

Nel premettere che, per il Lotto 16 non sono pervenute offerte e che per il Lotto 10 non si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, in quanto revocato, Il Presidente rappresenta che, come indicato nella sez. 18 del disciplinare di gara, qualora per i Lotti 1,2,3,4,6,7,9,11,13,15,17,18 e 19 l'operatore, per alcuni test considerati non obbligatori ai fini della validità dell'offerta, ha inserito la dicitura non disponibile, si procederà, ai fini della predisposizione della graduatoria di gara, ad associare al costo del test in trattazione il prezzo più alto offerto dai concorrenti ammessi in gara.

Viene inoltre rappresentato che per il lotto 9 non si procederà all'apertura dell'offerta economica presentata dall'operatore RECORD SEPARATION, il quale ha ritirato la propria offerta.

Lotto I Base d'asta € 2.500.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
RTI: BECKAM COULTIER/THERMO FISHER	€ 2.293.681,50	60,27	30,00	90,27	1	SI
BIOMERIEUX ITALIA	€ 2.317.423,00	58,40	26,55	84,95	2	SI
BECTON DICKINSON	€ 2.444.430,00	69,71	8,08	77,79	3	NO

Mf



Lotto 2 Base d'asta € 650.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
BIOMERIEUX ITALIA	€ 620.000,00	66,80	30,00	96,80	1	NO

Lotto 3 Base d'asta € 320.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
BECTON DICKINSON	€ 318.030,00	57,84	30,00	80,84	1	NO

Lotto 4 Base d'asta € 300.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
BIOMERIEUX ITALIA	€ 223.072,90	67,00	26,31	93,31	1	NO
ROCHE DIAGNOSTICS	€ 212.290,25	60,04	30,00	90,04	2	NO

Si precisa che l'operatore ROCHE DIAGNOSTICS ha, nell'ambito della propria offerta economica, dichiarato non disponibili i test di cui alle voci 18,19 e 20 e, pertanto, l'offerta dell'operatore è stata valorizzata, per effetto delle disposizioni di cui alla sez. 18 del disciplinare di gara, con le quotazioni proposte per i medesimi test dalla BIOMERIEUX ITALIA.

Lotto 5 Base d'asta € 2.250.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
ROCHE DIAGNOSTICS	1.047.413,40	65,86	30,00	95,86	1	SI
ABBOTT	1.051.000,00	61,31	29,21	91,22	2	SI
HOLOGIC ITALIA	1.123.375,00	50,47	28,11	78,58	3	NO
QIAGEN	1.830.820,40	53,14	10,46	63,60	4	NO

Mf *AS* *de* *2*



Lotto 6 Base d'asta € 1.150.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
RTI:ELETTROBIOCHI MICA/QIAGEN	€ 1.120.294,40	66,00	30,00	96,00	1	NO

Lotto 7 Base d'asta € 250.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
DIESE DIAGNOSTICA SENESE	€ 192.534,00	52,80	30,00	82,80	1	NO

Lotto 8 Base d'asta € 750.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
EUROSPITAL	€ 695.000,00	44,20	30,00	72,80	1	NO
DIASORIN	€ 747.500,00	64,50	1,36	65,86	2	NO
EFFEGIEMME	€ 746.510,55	47,90	1,90	49,80	3	NO

In merito all'offerta economica della DIASORIN, la Commissione, nell'esame della scheda E2 - costo dei reagenti -, prende atto che al raggiungimento in 12 mesi delle 65 unità offerte a pagamento (rispettivamente € 1.454,615 e € 750,00 per le due voci che compongono la scheda), le quotazioni in riferimento ai successivi ordini saranno pari a € 0,00.

Il Presidente evidenzia che i prezzi unitari delle due voci sono stati determinati dividendo il totale riga per 65.

Lotto 9 Base d'asta € 500.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
MERIDIEN BIOSCIENCE EUROPE	€ 210.075,00	60,42	30,00	90,42	1	SI
DID DIAGNOSTIC INTERNATIONAL	€ 227.700,00	61,02	28,18	89,20	2	SI



DISTRIBUTION						
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS	€ 386.770,00	63,90	11,72	75,62	3	NO
MASCIA BRUNELLI	€ 346.580,00	55,90	17,95	73,85	4	NO

Lotto 11 Base d'asta € 155.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
RTI:ALIFAX/DASIT	€ 129.391,25	65,00	30,00	90,42	1	NO

Lotto 12 Base d'asta € 550.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
DASIT	€ 197.382,80	68,60	30,00	98,60	1	NO

Lotto 13 Base d'asta € 225.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
FUJIREBIO ITALIA	€ 202.100,00	58,53	30,00	88,53	1	NO
ARNIKA	€ 222.900,00	51,57	2,75	54,32	2	NO

Si precisa che l'operatore FUJIREBIO ITALIA ha, nell'ambito della propria offerta economica, dichiarato non disponibile il test di cui alla voce 5 e, pertanto, l'offerta del predetto concorrente è stata valorizzata, per effetto delle disposizioni di cui alla sez. 18 del disciplinare di gara, con la quotazione proposta per il medesimo test dalla ARNIKA.

Lotto 14 Base d'asta € 900.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia

M B A₄




DASIT	€ 252.499,80	61,19	29,44	90,63	1	SI
QUIDEL ITALY	€ 310.500,00	60,67	26,81	87,48	2	SI
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS	€ 240.251,25	57,19	30,00	87,19	3	SI
RELAB	€ 368.875,00	61,33	24,15	85,48	4	SI
MASCIA BRUNELLI	€ 326.805,00	39,72	26,06	65,78	5	NO

Lotto 15 Base d'asta € 350.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
D.I.D. DIAGNOSTICS DISTRIBUTION	€ 221.278,00	56,60	30,00	86,60	1	NO

Lotto 17 Base d'asta € 300.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
BIOMERIEUX ITALIA	€ 291.975,00	62,60	30,00	92,60	1	NO

Lotto 18 Base d'asta € 1.700.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
ELETTROBIOCHIMICA	931.257,00	60,94	23,26	84,20	1	NO
ROCHE DIAGNOSTICS	1.024.185,00	56,78	20,45	77,23	2	NO
NUCLEAR LASER MEDICINE	708.365,00	47,23	30,00	77,23	3	NO
ELITECH GROUP	1.332.247,00	40,09	11,13	51,22	4	NO

My  



Si precisa che gli operatori ROCHE DIAGNOSTICS e ELETTOBIOCHIMICA hanno, nell'ambito della propria offerta economica, dichiarato non disponibili il test di cui alle voci 5 e 6 e, pertanto, le offerte dei predetti concorrenti sono state valorizzate, per effetto delle disposizioni di cui alla sez. 18 del disciplinare di gara, con le quotazioni proposte per i medesimi test dalla NUCLEAR LASER MEDICINE, i cui prezzi risultano superiori a quelli praticati dall'ELITECH GROUP.

In merito alla parità di punteggio per gli operatori ROCHE DIAGNOSTICS e NUCLEAR LASER MEDICINE, per determinare l'operatore secondo in graduatoria si tiene conto, ai sensi di quanto riportato alla sez. 22 del disciplinare, del maggiore punteggio tecnico assegnato alla ROCHE DIAGNOSTICS,

Lotto 19 Base d'asta € 175.000,00	Prezzo complessivo	P. Tecnico	P. economico	P. complessivo	Graduatoria	Sospetta di Anomalia
MEDICAL SYSTEMS	174.404,00	65,83	30,00	85,83	I	NO
DASIT	227.854,25	53,75	OFFERTA SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA			

Si precisa che l'operatore DASIT ha, nell'ambito della propria offerta economica, dichiarato non disponibile il test di cui alla voce 2 e, pertanto, l'offerta del predetto concorrente è stata valorizzata, per effetto delle disposizioni di cui alla sez. 18 del disciplinare di gara, con la quotazione proposta per il medesimo test dalla MEDICAL SYSTEMS. L'offerta complessiva della società DASIT, così determinata, pari a € 227.854,25, risulta superiore all'importo posto a base d'asta e, ai sensi di quanto stabilito negli atti di gara, non può essere presa in considerazione e pertanto viene esclusa.

I punteggi predetti e le graduatorie di gara per ogni lotto saranno riportate a sistema rese note a tutti i concorrenti il prossimo 10 giugno.

Alle ore 12,00 circa la seduta ha termine.

Il Presidente della Commissione

Dott. ssa Maria Letizia SCHIAVONE

Il Membro della Commissione

Dott. ssa Annunziata TAMBURRO

Il Membro della Commissione

Ing. Mariasole GIACUMMO

ALL 2

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**DIPARTIMENTO DEI LABORATORI
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA**

Protocollo 0071062

Tipo Interno Data 03/05/2021

Classificazione 01 06 05

Al Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

Al RUP della Procedura
Dott. Vittorio Santoriello

Oggetto: procedura aperta, indetta con Deliberazione n 325 del 14/04/2020, finalizzata all'affidamento della fornitura per 60 mesi in service suddivisa in 19 Lotti di sistemi macchine reagenti occorrenti al Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Ospedale San Filippo Neri, e per le linee di attività correlate, ai Laboratori del sistema HUB/SPOKE 3 della Regione Lazio. Lotto 10 "Reagenti per ricerche sierologiche varie"

Si rappresenta che le caratteristiche funzionali riportate negli elaborati di gara in merito al Lotto indicato in oggetto non risultano più compatibili con le mutate esigenze tecniche susseguenti all'installazione della strumentazione presso i laboratori dell'ASL Roma I di cui alla procedura aggiudicata con Deliberazione n. 819 del 02/10/2020.

Si rende necessario, pertanto, in autotutela, revocare il Lotto 10 della procedura, indetta con provvedimento deliberativo n. 325/2020, onde consentire l'attivazione di una iniziativa di gara che tenga debitamente conto della mutata situazione di fatto e risponda pienamente alle attuali esigenze gestionali ed operative dei Laboratori dell'Asl Roma I.

Cordiali saluti

Il Direttore Dipartimento dei Laboratori
Dott. Marcello Meledandri

Me

ALL 2



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Dipartimento Tecnico-patrimoniale
UOC Acquisizione Beni e Servizi
Roma, 5/05/2021

Ai membri
Della Commissione di gara

Oggetto: procedura aperta, indetta con Deliberazione n 325 del 14/04/2020, finalizzata all'affidamento della fornitura per 60 mesi in service suddivisa in 19 Lotti di sistemi macchine reagenti occorrenti al Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Ospedale San Filippo Neri, e per le linee di attività correlate, ai Laboratori del sistema HUB/SPOKE 3 della Regione Lazio.
Lotto 10 – Reagenti per ricerche serologiche varie

Si comunica che, per le ragioni esposte nella nota allegata del Direttore Dipartimento dei Laboratori, Dott. Marcello Meledandri, si rende opportuno revocare il lotto 10, non procedendo pertanto ad alcuna aggiudicazione in merito al Lotto medesimo.

Cordiali saluti

Il Rup della procedura
Dott. Vittorio Santoriello