



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0909 DEL 06/09/2018

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento alla Società GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. della fornitura di n. 1 Tavolo Telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA1. Importo complessivo € 205.700,00 IVA esclusa, pari ad € 250.954,00 IVA inclusa. CIG: 6951732EB6. Finanziamento regionale DGR 499/2011 ex ASL RMA.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico Patrimoniale - U.O.C. Ingegneria Clinica

Centro di costo: 769

L'estensore: Maria Pia Farallo *Maria Pia Farallo*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Pietro Barberini

Pietro Barberini

data 7.08.2018

Il Direttore

U.O.C. Ingegneria Clinica

Ing. Pietro Barberini

Pietro Barberini

data 7.08.2018

Il Direttore provvisorio

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

ASSENTE

data

Il presente atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Costo previsto: € 250.954,00 IVA inclusa - Bilancio Anno 2018 - C.P. 101020501 Attrezzature Sanitarie e Scientifiche .
Finanziamento regionale DGR 499/2011 ex ASL RMA.

Il Funzionario addetto al controllo di budget: Ing. Pietro Barberini

data 7.08.2018

firma

Pietro Barberini

Il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio:

data 20.08.2018

Dott.ssa Mirella Peracchi

firma

Mirella Peracchi

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole

data 3.11.2018

firma

Cristina Matranga

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole

data 4.9.2018

firma

Mauro Goletti

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Il presente provvedimento si compone di n. 56 pagine di cui n. 51 pagine di allegati

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Tanese

Angelo Tanese



N. 0909 DSL 06/09/2018

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016 del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1 gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

PREMESSO che con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 1 Tavolo Telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA1, per un importo complessivo a base di gara di € 210.000,00 IVA esclusa;

che entro le ore 12 del 18.04.2017, termine previsto nel bando di gara, hanno presentato offerta le seguenti Società:

- ASSING S.p.A.
- GILARDONI S.p.A.
- EUROIMAGING S.r.l.
- SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
- GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.

che con deliberazione n. 447 del 25/07/2017 e successiva delibera di sostituzione di un componente, n. 313 del 28/03/2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte presentate dalle Società partecipanti, così composta:

Presidente	Dott. Anastassios Chios	Dirigente Medico UOC Radiol. N.R.M.
Componente	Dott. Carmine Ciaralli	Coord.Tec.UOC Radiol. P.O. S.F. Neri
Componente	Ing. Pietro Barberini	Dir.UOC Ing. Clinica
Segretario	Maria Pia Farallo	Coll.Amm.vo uoc Ing. Clinica

EVIDENZIATO che con Delibera n. 670 del 10.07.2017 è stato affidato l'incarico di Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica all'Ing. Pietro Barberini;

che ai sensi dell'articolo 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, "nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto" (DEC) e che, come integrato dalle linee guida dell'ANAC, per prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, tale figura è soggetto diverso dal responsabile del procedimento;

che è pertanto necessario, individuare nella figura del DEC, il Perito Industriale Domenico Fanelli, Assistente Tecnico in servizio presso la U.O.C. Ingegneria Clinica di questa Azienda;

CONSIDERATO che la Commissione suddetta ha proceduto all'esame dei documenti presentati dalle Società concorrenti ed alla successiva valutazione delle offerte, in ottemperanza a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, come risulta dai verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati da n. 1 a n. 7);



che ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito valutazione delle offerte presentate dalle Società partecipanti alla procedura di gara pubblica, ha rilevato l'assenza di offerte anormalmente basse (**Allegato 8**);

che la procedura di gara di cui trattasi si è svolta secondo le procedure dell'evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, in attuazione della normativa comunitaria e statale di riferimento;

che ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati conclusi i controlli sui requisiti dichiarati dalla Società risultata provvisoriamente 1° aggiudicataria;

che questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare richiesta di Comunicazione Antimafia alla Prefettura territorialmente competente;

che trascorsi 30 giorni dalla richiesta si procederà, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011, alla stipula contrattuale anche in assenza della Comunicazione Antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del medesimo D.Lgs.;

RITENUTO

pertanto di affidare alla Società GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. la fornitura di n. 1 Tavolo Telecomandato digitale diretto occorrente alle esigenze della UOC Radiologia Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA1, per un importo complessivo di € 205.700,00 IVA esclusa, pari ad € 250.954,00 IVA inclusa, come da offerta allegata al presente provvedimento (**Allegato 9**);

ATTESO

che il Responsabile del budget ha accertato che la sottoscrizione del presente atto non comporta costi sul C.P. 101020501 – Attrezzature Sanitarie e Scientifiche in quanto trattasi di costi imputabili al Finanziamento regionale DGR 499/2001 ex ASL RMA;

che a seguito dell'adozione del presente atto il C.P. n. 101020501 – bilancio 2018 Attrezzature sanitarie e scientifiche – Finanziamento regionale DGR 499/2011 presenta la seguente situazione economica:

Budget assegnato DGR 499/2011		
Ex ASL RMA	€	1.597.080,00
Budget già impegnato	€	1.030.973,20
Importo impegnato con presente atto	€	250.954,00
Residuo	€	315.152,80

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:



- di affidare alla Società GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. la fornitura di n. 1 Tavolo Telecomandato digitale diretto occorrente alle esigenze della UOC Radiologia Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA1, per un importo complessivo di € 205.700,00 IVA esclusa, pari ad € 250.954,00 IVA inclusa, come da offerta allegata al presente provvedimento (**Allegato 9**);
- di nominare il Perito Industriale Domenico Fanelli, Assistente Tecnico in servizio preso la U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL ROMA1, quale DEC del contratto per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente al Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA 1;
- di imputare l'importo di € 250.954,00 IVA inclusa sul codice di costo n. 101020501 – Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - bilancio 2018;
- di utilizzare per l'acquisizione della suindicata apparecchiatura i fondi derivati dal Finanziamento regionale DGR 499/2011 ex ASL RMA;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Pietro Barberini

Il Direttore

U.O.C. Ingegneria Clinica

Ing. Pietro Barberini

Il Direttore provvisorio

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
ASSENTE**IL DIRETTORE GENERALE****IN VIRTÙ**

dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

LETTA

la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO

che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;



ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Aggiudicazione definitiva di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento alla Società GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. della fornitura di n. 1 Tavolo Telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA1. Importo complessivo € 205.700,00 IVA esclusa, pari ad € 250.954,00 IVA inclusa. CIG: 6951732EB6. Finanziamento regionale DGR 499/2011 ex ASL RMA";

e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di affidare alla Società GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. la fornitura di n. 1 Tavolo Telecomandato digitale diretto occorrente alle esigenze della UOC Radiologia Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA1, per un importo complessivo di € 205.700,00 IVA esclusa, pari ad € 250.954,00 IVA inclusa, come da offerta allegata al presente provvedimento (**Allegato 9**);
- di nominare il Perito Industriale Domenico Fanelli, Assistente Tecnico in servizio presso la U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL ROMA1, quale DEC del contratto per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente al Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA 1;
- di imputare l'importo di € 250.954,00 IVA inclusa sul codice di costo n. 101020501 – Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - bilancio 2018;
- di utilizzare per l'acquisizione della suindicata apparecchiatura i fondi derivati dal Finanziamento regionale DGR 499/2011 ex ASL RMA;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese

ALL. 1

ISTITUTO SANITARIO REGIONALE



ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC INGEGNERIA CLINICA**

Procedura Aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, per l'affidamento di una fornitura "chiavi in mano" di apparecchiature elettromedicali occorrenti ai Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL ROMA1. Lotti n. 1 e n. 3. Importo complessivo € 430.000,00 IVA esclusa. CIG Lotto 1: 6951732EB6; CIG Lotto 3: 695175300F.

Il giorno **25 settembre 2017 alle ore 10.00** presso la UOC Ingegneria Clinica della ASL ROMA1 – Piazza S. Maria della Pietà n. 5 - 00135 Roma, Pad. 90bis, il RUP, Dott.ssa Maddalena Quintili, con il supporto della segretaria della Commissione giudicatrice, Sig.ra Maria Pia Farallo, ai sensi della Linea Guida n. 3 "Nomina ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni" del D.Lgs. 50/2016, dà avvio all'espletamento della procedura di gara suindicata, con l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa.

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti società:

AGFA GEVAERT S.p.A.	Eugenio Pedace
ASSING S.p.A.	Antonio Leoni
GE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.	Vittorio Allamprese
GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.	Gerardino Gallo
GILARDONI S.p.A.	Pietro Trio
PHILIPS S.p.A.	Sandro Mattei
SIEMENS S.r.l.	Danièle Focassati

PER MERO ERRORE MATERIALE E' STATA APERTA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' DRAEGER PER IL LOTTO IV, REVOCATO E IN ATTESA DI INDIZIONE DI GARA.



Conclusa l'apertura e la verifica della documentazione presentata dalle società partecipanti il RUP comunica ai presenti che a seguito di successiva verifica della documentazione presentata, entro due giorni dalla data odierna sarà pubblicata sul sito aziendale l'ammissione/esclusione delle società alle successive fasi della procedura di gara.

Il Segretario della Commissione giudicatrice

Maria Pia Fafallo
Maria Pia Fafallo

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Maddalena Quintili



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura "chiavi in mano" di apparecchiature elettromedicali occorrenti ai presidi ospedalieri e territoriali della ASSL ROMA1. Lotti 1 e 3. Importo complessivo presunto € 430.000,00 IVA esclusa.

1° Seduta pubblica del 25 settembre 2017 – Apertura documentazione amministrativa

Rappresentanti delle Società presenti:

DITTA	COGNOME NOME	DOCUMENTO	DE LE GA	FIRMA
AGFA S.p.A.	PEDACE EUGENIO	V. ALLEGATO	SI	
ASSING S.p.A.	LEONI ANTONIO	P.A. U1M432386	SI	
DRÄGER S.p.A.				
EUROMAGING S.r.l.				
GE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.	ALLAMPRESSE ANTONIO (V. MAIL)	C.I. AY1265080 Roma 19.09.16	SI	
GENERAL M. S.p.A.	GALLO GERARDINO	V. ALLEGATO	SI	

Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6; n. 1 Sistema radiologico digitale occorrente alla UOC Radiologia Diagnostica del P.O. San Filippo Neri. Importo complessivo presunto € 220.000,00 IVA esclusa; CIG Lotto 3: 694189267F.

VERBALE N. 2

Seduta del 07.11.2017


A. Anon



L'anno 2017, il giorno martedì 7 novembre alle ore 12.00 presso la UOC Ingegneria Clinica della ASL ROMA1 - Piazza Santa Maria Pietà, 5 – 00135 Roma – Pad. 90bis – si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice delle offerte, relative alla Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6; n. 1 Sistema radiologico digitale occorrente alla UOC Radiologia Diagnostica del P.O. San Filippo Neri. Importo complessivo presunto € 220.000,00 IVA esclusa; CIG Lotto 3: 694189267F.

La Commissione, nominata con deliberazione n. 747 del 25/07/2017 è così composta:

Presidente	Dott. Anastassios Chios	Dirigente Medico UOC Diagnostica per Per Immagini Nuovo Regina Margherita
Componente	Dott. Carmine Ciaralli	Collaboratore Tecnico UOC Radiologia P.O. San Filippo Neri
Componente	Ing. Silvia Sergio	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica
Segretario	Maria Pia Farallo	Coll. Amm.vo U.O.C. Ingegneria Clinica

A seguito del comunicato pubblicato in data 25.10.2017 sulla Sezione di Amministrazione Trasparente "Gare e Appalti" del sito aziendale www.aslroma1.it, le Società partecipanti sono state invitate a presentarsi per l'apertura delle buste tecniche.


Assistono alla seduta pubblica i rappresentanti delle società partecipanti, come indicato nell'allegato **(Allegato 1)**.

La Commissione dopo aver verificato la rispondenza della documentazione presentata dalle società partecipanti a quanto richiesto dal CSA, dichiara le stesse ammesse alle successive fasi della procedura di gara.

Le buste sigillate contenenti le offerte economiche numerate da 1 a 5 sono custodite a cura del segretario nell'armadio situato presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Piazza S. Maria della Pietà, 5 – Pad. 90bis. Nello stesso armadio vengono custodite le buste contenenti la documentazione amministrativa e le buste contenenti le offerte tecniche aperte in data odierna.

Il Presidente alle ore 13.30 dichiara chiusa la seduta pubblica e invita le Società partecipanti ad uscire.

La Commissione alle ore 14.30 continua i lavori in seduta riservata e prima di procedere all'apertura e valutazione della documentazione tecnica, ribadisce i criteri stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto comprensivo dei suoi allegati, prende inoltre visione dei chiarimenti pervenuti e delle risposte pubblicate in relazione a tale procedura di gara.

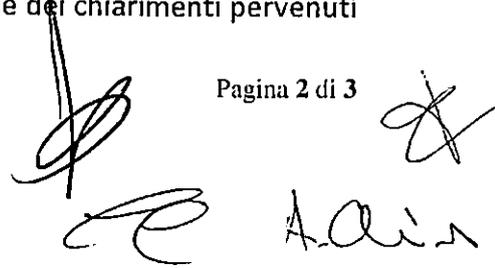

La Commissione pertanto procede con l'apertura e la disamina dei plichi contenenti la documentazione tecnica presentata dalle seguenti Società partecipanti per il lotto 1 - " Tavolo telecomandato digitale diretto":

ASSING S.p.A.
GILARDONI S.p.A.
EUROIMAGING S.r.l.
SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
GENERAL MEDICALMERATE S.p.A.

La Commissione verifica la documentazione presentata dalle società partecipanti, in merito ai requisiti minimi richiesti dal CSA. Giudicando le stesse confacenti alle specifiche minime richieste.

In relazione alla sola Società Siemens Healthcare, la Commissione rileva che all'interno dell'Allegato A1, presentato dalla stessa, al requisito "seggolini specifici per il contenimento di pazienti pediatrici" e "sedia dedicata con piano d'appoggio" è stato indicato la dicitura "si opzionale".


La Commissione ritiene la stessa idonea alla partecipazione alla successiva fase di analisi tecnica, riservandosi di verificare nelle successive sedute la documentazione presentata dalla società SIEMENS in merito al requisito suindicato.

Le buste sigillate contenenti le offerte economiche numerate da 1 a 5 sono custodite a cura del segretario nell'armadio situato presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Piazza S. Maria della Pietà, 5 – Pad. 90bis. Nello stesso armadio vengono custodite le buste contenenti la documentazione amministrativa e le buste contenenti le offerte tecniche.

La Commissione alle ore 16.30 dichiara chiusa la seduta riservata e decide di aggiornarsi a data da destinarsi, per la valutazione tecnica della documentazione presentata.

Il presente verbale, composto di n. 3 (tre) pagine e relativo allegato (n. 1) viene letto, confermato e sottoscritto:

PRESIDENTE
Dott. Anastassios Chios



COMPONENTI
Dott. Carmine Ciaralli



Ing. Silvia Sergio



SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Maria Pia Farallo





ALL. 1

ISTITUTO SANITARIO REGIONALE





Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura "chiavi in mano" di apparecchiature elettromedicali occorrenti ai presidi ospedalieri e territoriali della ASL ROMA1. Lotti 1 e 3. Importo complessivo presunto € 430.000,00 IVA esclusa.

1° Seduta pubblica del 7 novembre 2017 ore 12.00 – Apertura documentazione tecnica

Rappresentanti delle Società presenti:

NO

DITTA	COGNOME NOME	DOCUMENTO	DE LE GA	FIRMA
AGFA S.p.A.	LEONI ANTONIO	Q. P.A. UHL432386C 26.10.15	SI	
ASSING S.p.A.	↓	↓	↓	↓
EUROIMAGING	GIANNOTTI GIUSEPPE	P.A. UHL389622 02.03.15	SI	
GE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.	ALLAMITTESE VITTORIO	C.I.D. AV1265080 ROMA.190916	SI	
GENERAL M. S.p.A.	SPAGNA ALESSANDRO	Q. P.A. UHL855333H 25.11.15	SI	


GILARDONI S.p.A.	TRIO PIETRO	C. I.D. AS0396653 24.10.10	31	
PHILIPS S.p.A.	PAGLIARINI PAOLO	C. I.D. AR25484/190 GUIDONIA 02/10/2009	31	
SIEMENS S.r.l.	FOCASSATI DANIELE	C. I.D. AX5851881 FIANO ROMANO 18.05.16	81	



Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6.

VERBALE N. 3

Seduta del 30.11.2017



L'anno 2017, il giorno giovedì 30 novembre alle ore 10.00 presso la UOC Ingegneria Clinica della ASL ROMA1 - Piazza Santa Maria Pietà, 5 - 00135 Roma - Pad. 90bis - si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice delle offerte, relative alla Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6;

La Commissione, nominata con deliberazione n. 747 del 25/07/2017 è così composta:

Presidente	Dott. Anastassios Chios	Dirigente Medico UOC Diagnostica per Per Immagini Nuovo Regina Margherita
Componente	Dott. Carmine Ciaralli	Collaboratore Tecnico UOC Radiologia P.O. San Filippo Neri
Componente	Ing. Silvia Sergio	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica
Segretario	Maria Pia Farallo	Coll. Amm.vo U.O.C. Ingegneria Clinica

Il Presidente constatata la regolarità della composizione della Commissione suindicata, inizia i lavori in seduta riservata, richiamando i contenuti del verbale n. 2 del 07/11/2017.


La Commissione procede alla valutazione degli elementi di natura tecnica sulla base dell'analisi della documentazione e del progetto proposto, attribuendo i punteggi a ciascuna delle caratteristiche tecnico-funzionali così come indicato nell'Allegato B "Tabella di Valutazione" del CSA.

Le Società partecipanti per il lotto 1 - " Tavolo telecomandato digitale diretto" sono le seguenti:

ASSING S.p.A.
GILARDONI S.p.A.
EUROIMAGING S.r.l.
SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.

I parametri di valutazione presenti all'interno della suddetta Tabella di Valutazione prevedono, in talune voci, l'attribuzione del punteggio in modo empirico in funzione dei parametri dichiarati dalle singole Società partecipanti.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto opportuno procedere con l'attribuzione dei punteggi relativi ai suddetti parametri. In particolare ha effettuato le seguenti valutazioni:

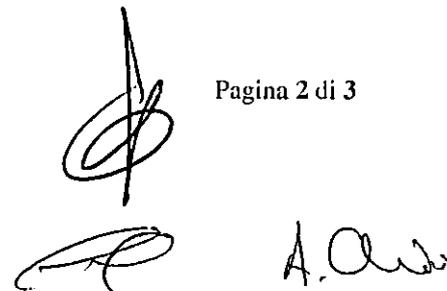The page contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a large, stylized signature. Below it, on the left, is another signature. On the right, there are initials that appear to be 'A. O. ...'.

Caratteristiche tecniche del generatore ad alta frequenza e tubo RX

(Potenza massima erogabile, Numero massimo di immagini acquisite in grafia, Distanza fuoco - film, Acquisizioni di proiezioni oblique)

Caratteristiche tecniche del tavolo porta paziente

(Minima altezza da terra, Massimo peso supportabile senza limitazioni di peso)

Caratteristiche tecniche del detettore digitale dinamico tipo flat panel

(Dimensione superficie attiva del detettore, Massimo Dimensione fisiche del pixel)

Caratteristiche tecniche della consolle di comando e preview per la sala comando

(Doppia consolle di comando, Dimensione display, Capacità di archiviazione locale espressa in numero di immagini archiviate)

Si rimanda l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del parametro "Capacità di archiviazione locale espressa in numero di immagini archiviate" in quanto il suddetto dati non risulta rilevabile in maniera univoca dalla documentazione di gara allegata presentata dalla singole Società. Si ritiene pertanto necessario inviare, in fase successiva, una richiesta di chiarimento alle Società partecipanti per consentire una adeguata valutazione del parametro di interesse.

Conclusa la suddetta disamina tecnica offerta dalle Società partecipanti si procede all'attribuzione dei punteggi secondo quanto sopra esposto, si allega la scheda dettagliata della valutazione tecnica effettuata (Allegato 1).


Le buste sigillate contenenti le offerte economiche numerate da 1 a 5 sono custodite a cura del segretario nell'armadio situato presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Piazza S. Maria della Pietà, 5 – Pad. 90bis. Nello stesso armadio vengono custodite le buste contenenti la documentazione amministrativa e le buste contenenti le offerte tecniche.

La Commissione alle ore 14.30 chiude la seduta riservata e decide di aggiornarsi a data da destinarsi.

Il presente verbale, composto di n. 3 (tre) pagine e relativo allegato (n. 1) viene letto, confermato e sottoscritto:


PRESIDENTE

Dott. Anastassios Chios




COMPONENTI

Dott. Carmine Ciaralli




Ing. Silvia Sergio



SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Sig.ra Maria Pia Farallo





Allegato n. 1 Verbale n. 3

GENERATORE AD ALTA FREQUENZA E TUBO RX					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Potenza massima erogabile (punti max 2)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero massimo di immagini acquisite in grafia (punti max 3)	3,00	0,29	0,00	0,50	1,57
Distanza fuoco-film(punti max 2)	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Acquisizione di proiezioni oblique (punti max 1)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TAVOLO PORTA PAZIENTE					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Minima altezza da terra (punti max 3)	3,00	1,20	1,20	1,80	0,00
Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento (punti max 2)	1,18	2,00	0,00	0,56	1,65
DETTETTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dimensioni superficie attiva del detettore (punti max 2)	2,00	2,00	0,59	0,00	2,00
Dimensioni fisiche del pixel (punti max 3)	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
CONSOLE DI COMANDO E PREVIEW PER SALA COMANDO					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Doppia consolle di comando (punti max 2)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dimensioni dei display (punti max 2)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

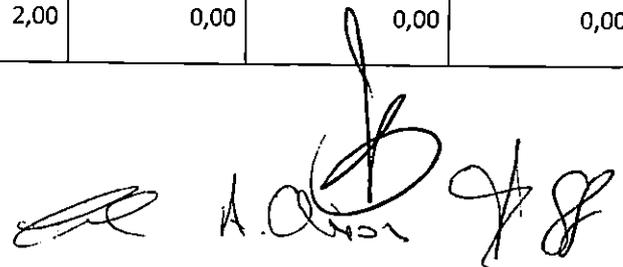


ALL. 4

Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6.

VERBALE N. 4

Seduta del 13.02.2018

A. Cris
 

L'anno 2018, il giorno martedì 13 febbraio alle ore 10.00 presso la UOC Ingegneria Clinica della ASL ROMA1 - Piazza Santa Maria Pietà, 5 - 00135 Roma - Pad. 90bis - si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice delle offerte, relative alla Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6;

La Commissione, nominata con deliberazione n. 747 del 25/07/2017 è così composta:

Presidente	Dott. Anastassios Chios	Dirigente Medico UOC Diagnostica per Per Immagini Nuovo Regina Margherita
Componente	Dott. Carmine Ciaralli	Collaboratore Tecnico UOC Radiologia P.O. San Filippo Neri
Componente	Ing. Silvia Sergio	Ingegnere Biomedico UOC Ingegneria Clinica
Segretario	Maria Pia Farallo	Coll. Amm.vo U.O.C. Ingegneria Clinica

Il Presidente constatata la regolarità della composizione della Commissione suindicata, inizia i lavori in seduta riservata, richiamando i contenuti dei precedenti verbali n. 2 del 07/11/2017 e n. 3 del 30/11/2017.

La Commissione procede alla valutazione degli elementi di natura tecnica sulla base dell'analisi della documentazione e del progetto proposto, attribuendo i punteggi a ciascuna delle caratteristiche tecnico-funzionali così come indicato nell'Allegato B "Tabella di Valutazione" del CSA.

Di seguito si evidenzia nel dettaglio le caratteristiche valutate presentate dalle seguenti Società partecipanti per il lotto 1 - "Tavolo telecomandato digitale diretto:


ASSING S.p.A.
GILARDONI S.p.A.
EUROIMAGING S.r.l.
SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.

CARATTERISTICHE GENERATORE AD ALTA FREQUENZA E TUBO RX

Collimatore automatico con filtri addizionali motorizzati

Tutte le Società partecipanti offrono un'apparecchiatura dotata di un collimatore automatico con filtri addizionali motorizzati, in particolare:

- le Società ASSING e GILARDONI presentano un sistema di filtri addizionali discreto composto da strati di Alluminio per i tre filtri più spessi in particolare, per la prima da 1

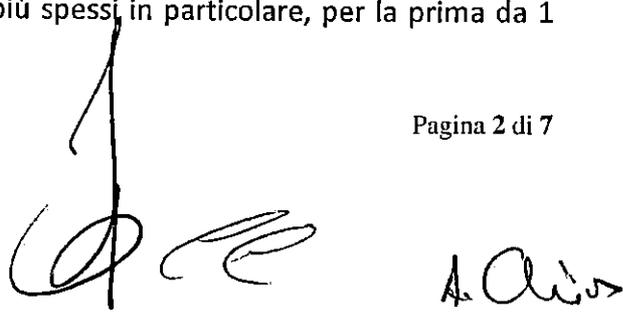

- mm Al con 0,1 mm Cu, 1 mm Al con 0,2 mm Cu, e 2 mm Al senza Cu, per la seconda da 1mm Al con 0,2 Cu, Al 1 mm con 0,1 Cu e da 2 mm Al senza Cu
- le Società SIEMENS HEALTHCARE e EUROIMAGING presentano un sistema di filtri addizionali distinto composto in entrambe dalla sola presenza di rame in particolare pari a 0,1 mm Cu 0, 2 mm Cu e 0,3 mm Cu
- la Società GENERAL MEDICAL MERATE presenta un sistema di filtri addizionali ottimo con uno strato più sottile costituito da 0,5 mm Al con 0,1 mm Cu, 0,5 mm Al con 0,2 mm Cu e 0,5 mm Al senza Cu

Posizionamento automatico e/o motorizzato dello stativo in funzione alla tipologia d'esame

Tutte le Società partecipanti offrono un'apparecchiatura con un buon sistema di posizionamento automatico e motorizzato in funzione della tipologia d'esame programmato.

Efficacia diagnostica del sistema composto da generatore e tubo radiogeno

Per la valutazione dell'efficacia diagnostica sono stati valutati per ogni apparecchiatura presentata, i valori di dissipazione e capacità dell'anodo rotante, la grandezza dei fuochi e la velocità dell'anodo rotante.

- la Società GILARDONI raggiunge un giudizio complessivo risultante da un grado buono sui parametri relativi alla dissipazione e alla capacità di accumulo, un grado sufficiente sulla grandezza dei fuochi e un grado discreto sulla velocità dell'anodo;
- la Società ASSING raggiunge un giudizio complessivo risultante da un grado ottimo sui parametri relativi alla dissipazione e alla capacità di accumulo, un grado sufficiente sulla grandezza dei fuochi e un grado sufficiente sulla velocità dell'anodo;
- la Società EUROIMAGING raggiunge un giudizio complessivo risultante da un grado buono sui parametri relativi alla dissipazione e alla capacità di accumulo, un grado buono sulla grandezza dei fuochi e un grado discreto sulla velocità dell'anodo;
- la Società SIEMENS HEALTHCARE raggiunge un giudizio complessivo risultante da un grado ottimo sui parametri relativi alla dissipazione e alla capacità di accumulo, un grado ottimo sulla grandezza dei fuochi e un grado sufficiente sulla velocità dell'anodo;
- la Società GENERAL MEDICAL MERATE raggiunge un giudizio complessivo risultante da un grado ottimo sui parametri relativi alla dissipazione e alla capacità di accumulo, un grado ottimo sulla grandezza dei fuochi e un grado ottimo sulla velocità dell'anodo.

CARATTERISTICHE TAVOLO PORTAPAZIENTE

Altre caratteristiche del tavolo porta paziente

- le Società ASSING e GILARDONI hanno presentato delle apparecchiature con caratteristiche aggiuntive sufficienti: il tavolo non è a sbalzo, inoltre per scansioni più difficoltose l'escursione non è sufficiente a consentire un unico scanni ed è necessario pertanto riposizionare il paziente;
- le Società SIEMENS HEALTHCARE ed EUROIMAGING hanno presentato delle apparecchiature con caratteristiche aggiuntive distinte. La SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. offre un tavolo senza sbalzo ma con escursione tale da consentire uno scanning completo anche in scansioni più difficoltose senza la necessità di posizionare il paziente. La EUROIMAGING S.r.l. offre un tavolo con sbalzo e la sua escursione è tale da consentire uno scanning completo anche in scansioni più difficoltose senza la necessità di posizionare il paziente;




– la Società GENERAL MEDICAL MERATE ha presentato un'apparecchiatura con caratteristiche aggiuntive ottime: il tavolo ha lo sbalzo, l'accesso al paziente barellato è consentito con estrema semplicità avendo spazio aperto intorno al tavolo.

CARATTERISTICHE DETETTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL

Efficacia diagnostica del sistema

La Società EUROIMAGING ha presentato un ottimo detettore (VARIAN) con un QEF maggiore rispetto a quello offerto (RF 43) dalle altre Società partecipanti comunque di distinte proprietà.

CARATTERISTICHE CONSOLLE DI COMANDO E PREVIEW PER LA SALA COMANDO

Sistema di misurazione durante il processo di acquisizione dei dati

- La Società GILARDONI raggiunge un giudizio sufficiente: non si evince dalla documentazione presentata sistemi specifici per la misurazione;
- la Società EUROIMAGING raggiunge un giudizio discreto: il sistema consente di effettuare misurazioni lineari e angolari mentre non si evincono particolari sistemi di misurazione della dose;
- la Società ASSING raggiunge un giudizio buono: il sistema consente di effettuare misurazioni lineari e angolari.
- le Società SIEMENS HEALTHCARE E GENERAL MEDICAL MERATE raggiungono un giudizio ottimo: i sistemi oltre a consentire misurazioni lineari, angolari e misurazione della dose sono dotati particolari software aggiuntivi per vari tipi di misurazioni (campi di vista, frame, ms, KVA...).

Qualità dei pacchetti software inseriti

- Le Società ASSING, SIEMENS HEALTHCARE e GENERAL MEDICA MERATE raggiungono un giudizio complessivo ottimo offrendo dei pacchetti software completi anche per la rielaborazione delle immagini per varie specialità;
- la Società EUROIMAGING raggiunge un buon giudizio complessivo offrendo vari pacchetti software anche se non altamente specifici;
- la Società GILARDONI raggiunge un giudizio complessivo sufficiente offrendo pacchetti software classici e di base.

Efficacia diagnostica del sistema

- Le Società EUROIMAGING e GILARDONI non presentano caratteristiche aggiuntive rispetto a quanto già precedentemente valutato, pertanto si fornisce un giudizio sufficiente;
- la Società ASSING presenta delle buone migliorie rispetto a quanto non valutato in precedenza (numero maggiore di joystick con comandi personalizzati, presenza di n. 3 tastiere, facile metodo di disinserimento degli automatismi);



f. Anis

- le Società SIEMENS HEALTHCARE e GENERAL MEDICAL MERATE presentano delle ottime migliorie rispetto a quanto non valutato in precedenza (ottime caratteristiche del processore che garantisce una elevata qualità delle immagini in tutti gli esami anche con mezzo di contrasto, movimento di elevazione indipendente dal ribaltamento per entrambe le apparecchiature offerte).

CARATTERISTICHE SULLA SICUREZZA

Caratteristiche del sistema di riduzione e monitoraggio della dose assorbita

- Le Società GILARDONI e EUROIMAGING presentano un sistema di media protezione con un controllo automatico della dose tramite dosimetro e sistemi di filtri automatici, complessivamente si fornisce un giudizio discreto;
- le Società ASSING, SIEMENS HEALTHCARE e GENERAL MEDICAL MERATE presentano un sistema di elevata protezione, i piani porta paziente sono in fibra di carbonio per ASSING e GENERAL MEDICAL MERATE, per la SIEMENS HEALTHCARE sono offerte delle griglie con elevata trasparenza e removibili, le tre società inoltre offrono sistemi di monitoraggio in continuo e un centramento virtuale con simulazioni, il giudizio complessivo è ottimo.

Utilità delle altre caratteristiche progettuali finalizzate ad incrementare il livello di sicurezza dei sistemi

- Le Società GILARDONI e EUROIMAGING non specificano la tipologia degli accessori forniti a corredo (sedia pediatrica e sedia radiotrasparente) dedicati agli esami di defecografia e deglutizione. La prima Società inoltre fornisce un sistema di protezione dei cavi medio mentre la seconda Società dichiara di avere un controllo sul carico di lavoro del tubo essenziale per evitare il surriscaldamento dello stesso. Complessivamente si fornisce un giudizio discreto ad entrambi i sistemi;
- la Società ASSING presenta un sistema di protezione cavi sufficiente, è presente inoltre una buona segnaletica di pericolo. Gli accessori forniti a corredo per gli esami di defecografia e deglutizioni (sedia radiotrasparente e sedia pediatrica) sono idonei, si evidenzia tuttavia che non è possibile fissare al tavolo la sedia radiotrasparente. Il giudizio complessivo è buono;
- la Società SIEMENS HEALTHCARE presenta un sistema con un ottima protezione dei cavi (a carro armato) e una serie di comandi e sistemi di protezione distinti, non si evincono le caratteristiche dei degli accessori forniti a corredo dedicati agli esami di defecografia e deglutizione (sedia radiotrasparente e sedia pediatrica). Il giudizio complessivo è distinto;
- la Società GENERAL MEDICAL MERATE presenta un sistema con ottima protezione dei cavi (a carro armato), un sistema di protezione ottimo con segnalazioni acustiche e visive. Gli accessori forniti a corredo dedicati agli esami di defecografia e deglutizione (sedia radiotrasparente e sedia pediatrica) sono idonei e presentano entrambi dei sistemi che consentano l'aggancio al tavolo e l'ancoraggio alla pedana. Il giudizio complessivo è ottimo.



CARATTERISTICHE PIANO FORMATIVO

Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste

- La Società ASSING fornisce un piano formativo della durata di tre giorni per operatori tecnici e sanitari, il giudizio è sufficiente;
- le Società GILARDONI e SIEMENS HEALTHCARE forniscono un piano formativo della durata di cinque giorni per operatori tecnici e sanitari, il giudizio è discreto;
- la Società EUROIMAGING fornisce un piano formativo della durata di cinque giorni, un corso aggiuntivo della durata di un giorno a distanza di un mese dal primo periodo di formazione e un ulteriore giorno dopo un anno. Il corso è rivolto a operatori tecnici e sanitari, il giudizio è distinto;
- la Società GENERAL MEDICAL MERATE fornisce un piano formativo della durata di cinque giorni, con periodi di formazione gratuiti aggiuntivi per tutta la durata della garanzia. Il corso è rivolto a operatori tecnici e sanitaria, il giudizio è ottimo.

La Commissione, rileva dal CSA che è contemplata una soglia di sbarramento pari a 31/60 con riferimento ai parametri individuati dalla "Tabella di Valutazione" Allegato B, pertanto le Società che non raggiungeranno tale punteggio non saranno ammesse al conteggio dei punti dei parametri quantitativi (assistenza tecnica e prezzo).

La Commissione decide comunque di quantificare il punteggio relativo all'assistenza tecnica riservandosi di aggiungere il totale alle sole Società che superano la suddetta soglia di sbarramento.

CARATTERISTICHE ASSISTENZA TECNICA

Servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita


Si quantificano il numero di mesi di garanzia offerti in aggiunta ai 24 mesi richiesti, in particolare:

- Le Società ASSING, GILARDONI, EUROIMAGING, SIEMENS HEALTHCARE offrono i 24 mesi richiesti pertanto il punteggio relativo secondo la formula indicata nel CSA è pari a 0,00 (zero);
- la Società GENERAL MEDICAL MERATE offre 36 mesi di garanzia, il punteggio relativo secondo la formula indicata nel CSA è pari a 3,00 (tre).

Manutenzione straordinaria e ordinaria

Si quantificano i tempi di intervento e risoluzione del guasto, in particolare:

- La Società GILARDONI dichiara un tempo di intervento pari a 8 ore lavorative e un tempo di risoluzione entro 4 ore dall'arrivo del tecnico, la Società SIEMENS HEALTHCARE dichiara un tempo intervento entro le 4 ore lavorative e un tempo di risoluzione entro 12 ore dall'individuazione del guasto, la Società EUROIMAGING dichiara un tempo di intervento 24 ore solari (8 lavorative) e un tempo risoluzione del guasto entro le 24 solari (8 lavorative). Complessivamente il giudizio per tali Società è buono;

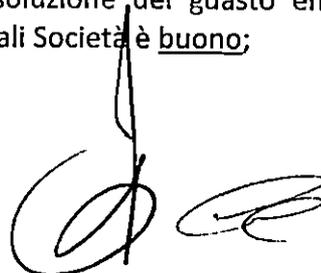

- la Società GENERAL MEDICAL MERATE dichiara un tempo di intervento entro 2 ore dalla chiamata e un tempo di risoluzione del guasto entro le 24 ore solari (8 lavorative), il giudizio complessivo è distinto;
- la Società ASSING dichiara un tempo di intervento pari a 1 ora e un tempo di risoluzione pari a 2 ore, il giudizio complessivo è ottimo.

Conclusa la suddetta disamina tecnica offerta dalle Società partecipanti si procede all'attribuzione dei punteggi secondo quanto sopra esposto, si allega la scheda dettagliata della valutazione tecnica effettuata (Allegato 1).

La Commissione alle ore 15.30 chiude la seduta riservata, e decide di aggiornarsi a data da destinarsi.

Le buste sigillate contenenti le offerte economiche numerate da 1 a 5 sono custodite a cura del segretario nell'armadio situato presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica - Piazza S. Maria della Pietà, 5 - Pad. 90bis. Nello stesso armadio vengono custodite le buste contenenti la documentazione amministrativa e le buste contenenti le offerte tecniche.

Il presente verbale, composto di n. 7 (sette) pagine e relativo allegato (n. 1) viene letto, confermato e sottoscritto:

PRESIDENTE
Dott. Anastassios Chios

Anastassios Chios

COMPONENTI
Dott. Carmine Ciaralli

Carmine Ciaralli

Ing. Silvia Sergio

Silvia Sergio


SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Maria Pia Farallo

Maria Pia Farallo

A. Chios

Allegato n. 1 Verbale n. 4

GENERATORE AD ALTA FREQUENZA E TUBO RX					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Collimatore automatico con filtri addizionali motorizzati (punti max 2)	0,50	0,50	1,50	1,50	2,00
Posizionamento automatico e/o motorizzato dello stativo in funzione alla tipologia d'esame (punti max 3)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Efficacia diagnostica del sistema composto da generatore e tubo radiogeno (punti max 6)	2,00	1,25	4,00	2,25	6,00
TAVOLO PORTA PAZIENTE					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Altre caratteristiche del tavolo portapaziente (punti max 3)	0,00	0,00	2,25	2,25	3,00
DETETTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Efficacia diagnostica del sistema (punti max 3)	2,25	2,25	2,25	3,00	2,25
CONSOLLE DI COMANDO E PREVIEW PER SALA COMANDO					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Sistema di misurazione durante il processo di acquisizione dei dati (punti max 4)	2,00	0,00	4,00	1,00	4,00
Qualità dei pacchetti software inseriti (punti max 2)	2,00	0,00	2,00	1,00	2,00
Efficacia diagnostica del sistema (punti max 5)	2,50	0,00	5,00	0,00	5,00

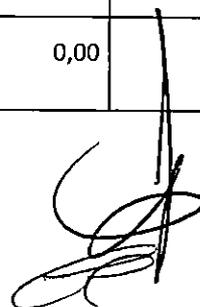
A. di...




SICUREZZA					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Caratteristiche del sistema di riduzione e monitoraggio della dose assorbita (punti max 3)	3,00	0,75	3,00	0,75	3,00
Utilità delle altre caratteristiche progettuali finalizzate ad incrementare il livello di sicurezza dei sistemi (punti max 3)	1,50	0,75	2,25	0,75	3,00
FORMAZIONE					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste (punti max 3)	0,00	0,75	0,75	1,50	3,00
ASSISTENZA TECNICA					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita (punti max 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Manutenzione straordinaria e ordinaria (punti max 2)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,50

A. C...

ALL. 5

Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6.

VERBALE N. 5

Seduta del 24.04.2018

A. C...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

L'anno 2018, il giorno martedì 24 aprile alle ore 10.00 presso la UOC Ingegneria Clinica della ASL ROMA1 - Piazza Santa Maria Pietà, 5 – 00135 Roma – Pad. 90bis – si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice delle offerte, relative alla Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6.

La Commissione, nominata con deliberazione n. 747 del 25/07/2017, e successiva delibera di sostituzione di un componente n. 313 del 28/03/2018 è così composta:

Presidente	Dott. Anastassios Chios	Dirigente Medico UOC Diagnostica per Per Immagini Nuovo Regina Margherita
Componente	Dott. Carmine Ciaralli	Collaboratore Tecnico UOC Radiologia P.O. San Filippo Neri
Componente	Ing. Pietro Barberini	Direttore UOC Ingegneria Clinica
Segretario	Maria Pia Farallo	Coll. Amm.vo U.O.C. Ingegneria Clinica

Il Presidente constatata la regolarità della composizione della Commissione suindicata, inizia i lavori in seduta riservata, richiamando i contenuti dei precedenti verbali.

L'Ing. Pietro Barberini, nominato componente della Commissione giudicatrice con delibera n. 313 del 28/03/2018, in sostituzione del Componente Ing. Silvia Sergio, prende atto del lavoro svolto dalla Commissione nelle precedenti sedute, come specificato nei verbali n. 2, 3 e 4.

La Commissione inizia pertanto i lavori proseguendo con la disamina della documentazione tecnica relativa alla fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto presentata dalle singole Società di seguito indicate:

- ASSING S.p.A.
- GILARDONI S.p.A.
- EUROIMAGING S.r.l.
- SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
- GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.


Alla luce di quanto già esaminato nelle precedenti sedute e in particolare secondo quanto evidenziato nei verbali n. 2 del 07.11.2017 e n. 3 del 30.11.2017, la Commissione decide di inviare le seguenti richieste di chiarimenti a tutte le ditte partecipanti:

- in merito alla caratteristica V16 di cui all'allegato B e B1, si chiede di indicare la capacità in termine di numero di immagini archiviabili localmente dedicata alla memorizzazione delle stesse alla matrice 1Kx1K;

A. Chios





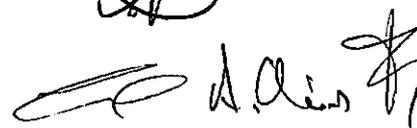

- alla Società SIEMENS HEALTHCARE, in relazione alle caratteristiche minime (Allegato A1) si chiede ulteriormente di specificare cosa si intende per opzionale alle voci "seggolini specifici per il contenimento di pazienti pediatrici", e "sedia dedicata con piano d'appoggio".

La Commissione dà mandato al segretario di inviare le suindicate richieste alle società con l'indicare di riscontro entro il 9 maggio 2018.


La Commissione alle ore 13.30 chiude la seduta riservata, e decide di aggiornarsi a data da destinarsi.

Le buste sigillate contenenti le offerte economiche numerate da 1 a 5 sono custodite a cura del segretario nell'armadio situato presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica - Piazza S. Maria della Pietà, 5 - Pad. 90bis. Nello stesso armadio vengono custodite le buste contenenti la documentazione amministrativa e le buste contenenti le offerte tecniche.

Il presente verbale, composto di n. 3 (tre) pagine viene letto, confermato e sottoscritto:


PRESIDENTE

Dott. Anastassios Chios




COMPONENTI

Dott. Carmine Ciaralli




Ing. Pietro Barberini



SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Maria Pia Farallo



ALL. 6

Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6.

VERBALE N. 6

Seduta del 29.05.2018



A. Chiaro

L'anno 2018, il giorno martedì 29 maggio alle ore 10.30 presso la UOC Ingegneria Clinica della ASL ROMA1 - Piazza Santa Maria Pietà, 5 – 00135 Roma – Pad. 90bis – si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice delle offerte, relative alla Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6;

La Commissione, nominata con deliberazione n. 747 del 25/07/2017, e successiva delibera di sostituzione di un componente n. 313 del 28/03/2018 è così composta:

Presidente	Dott. Anastassios Chios	Dirigente Medico UOC Diagnostica per Per Immagini Nuovo Regina Margherita
Componente	Dott. Carmine Ciaralli	Collaboratore Tecnico UOC Radiologia P.O. San Filippo Neri
Componente	Ing. Pietro Barberini	Direttore UOC Ingegneria Clinica
Segretario	Maria Pia Farallo	Coll. Amm.vo U.O.C. Ingegneria Clinica

Il Presidente constatata la regolarità della composizione della Commissione suindicata, inizia i lavori in seduta riservata, richiamando i contenuti dei verbali precedenti.


Le Società partecipanti per la fornitura di "n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto" sono le seguenti:

ASSING S.p.A.
GILARDONI S.p.A.
EUROIMAGING S.r.l.
SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.

La Commissione, prende visione dei chiarimenti pervenuti a seguito della richiesta inviata a tutte le società partecipanti, con note prot. n. 51577 del 24/04/2018, n. 51586 del 24/04/2018, n. 51887 del 26/04/2018, n. 51869 del 26/04/2018, n.51875 del 26/04/2018 e n. 51902 del 26/04/2018, depositate agli atti d'ufficio della UOC Ingegneria Clinica.

La Commissione ritiene soddisfacente quanto indicato nei chiarimenti pervenuti, e attribuisce i punteggi tecnici relativi al parametro V16 della "Tabella di Valutazione" Allegato B.

Quindi si procede all'attribuzione del punteggio relativo al parametro di valutazione V16 e al conteggio dei punteggi totali relativi ai parametri qualitativi espressi nella "Tabella di Valutazione" Allegato B, di cui si allega tabella riepilogativa (Allegato 1).



A. Ciaralli

I punteggi pertanto risultanti dai parametri valutati secondo quanto indicato nell'Allegato B – "Tabella di Valutazione" del CSA sono i seguenti:

ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
33,65	<u>20,28</u>	33,32	<u>24,36</u>	45,97

Si evidenzia che la GILARDONI S.p.A. raggiunge un punteggio pari a 20,28 e la EUROIMAGING S.r.l. raggiunge un punteggio pari a 24,36.

Per quanto indicato nel CSA, pertanto, le suddette Società non superano la soglia di sbarramento (31/60), e non sono ammesse nelle valutazioni successive relativi all'assistenza tecnica e alla fase pubblica di apertura della busta contenente l'offerta economica.


La Commissione, attribuisce il punteggio associato alla Voce "Assistenza Tecnica" alle sole Società ASSING, SIEMENS HEALTHCARE e GENERAL MEDICAL MERATE, così come quantificati nel verbale n. 4.

I punteggi definitivi pertanto sono i seguenti:

ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
35,65	<u>NON AMMESSA</u>	34,32	<u>NON AMMESSA</u>	50,47

La Commissione alle ore 14.30 chiude la seduta pubblica, e decide di aggiornarsi al giorno 26 giugno alle ore 10.00 in seduta pubblica per la lettura dei punteggi tecnici definitivi e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Le buste sigillate contenenti le offerte economiche numerate da 1 a 5 sono custodite a cura del segretario nell'armadio situato presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Piazza S. Maria della Pietà, 5 – Pad. 90bis. Nello stesso armadio vengono custodite le buste contenenti la documentazione amministrativa e le buste contenenti le offerte tecniche.

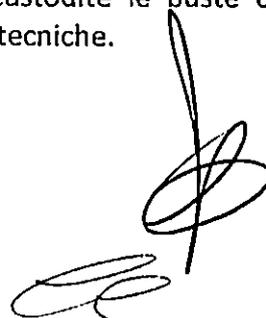

A. C. ...



Il presente verbale, composto di n. 7 (sette) pagine di cui n. 3 pagine di allegato (n. 1) viene letto, confermato e sottoscritto:

PRESIDENTE

Dott. Anastassios Chios

Anastassios Chios

COMPONENTI

Dott. Carmine Ciaralli

Carmine Ciaralli


Ing. Pietro Barberini

Pietro Barberini

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Maria Pia Farallo

Maria Pia Farallo

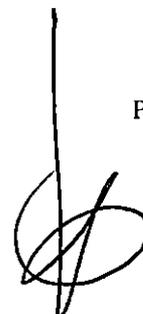

Allegato n. 1 Verbale n. 6


Il valore del parametro V16 non ancora valutato è il seguente:

CONSOLLE DI COMANDO E PREVIEW PER SALA COMANDO					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Capacità di archiviazione locale (espressa in numero di immagini archiviate) (punti max 1)	0,22	0,04	0,03	0,00	1,00

Di seguito i valori riepilogativi dei punteggi assegnati ai parametri individuati dalla Tabella di Valutazione – Allegato B:

GENERATORE AD ALTA FREQUENZA E TUBO RX					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
V1: Potenza massima erogabile (punti max 2)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V2: Numero massimo di immagini acquisite in grafia (punti max 3)	3,00	0,29	0,00	0,50	1,57
V3: Collimatore automatico con filtri addizionali motorizzati (punti max 2)	0,50	0,50	1,50	1,50	2,00
V4: Distanza fuoco-film (punti max 2)	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
V5: Acquisizione di proiezioni oblique (punti max 1)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
V6: Posizionamento automatico e/o motorizzato dello stativo in funzione alla tipologia d'esame (punti max 3)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
V7: Efficacia diagnostica del sistema composto da generatore e tubo radiogeno (punti max 6)	2,00	1,25	4,00	2,25	6,00
TAVOLO PORTA PAZIENTE					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
V8: Minima altezza da terra (punti max 3)	3,00	1,20	1,20	1,80	0,00




A. Olivero

V9: Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento (punti max 2)	1,18	2,00	0,00	0,56	1,65
V10: Altre caratteristiche del tavolo portapaziente (punti max 3)	0,00	0,00	2,25	2,25	3,00

DETTETTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL

	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
V11: Dimensioni superficie attiva del detettore (punti max 2)	2,00	2,00	0,59	0,00	2,00
V12: Dimensioni fisiche del pixel (punti max 3)	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
V13: Efficacia diagnostica del sistema (punti max 3)	2,25	2,25	2,25	3,00	2,25

CONSOLE DI COMANDO E PREVIEW PER SALA COMANDO

	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
V14: Doppia consolle di comando (punti max 2)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
V15: Dimensioni dei display (punti max 2)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
V16: Capacità di archiviazione locale (espressa in numero di immagini archiviate)	0,22	0,04	0,03	0,00	1,00
V17: Sistema di misurazione durante il processo di acquisizione dei dati (punti max 4)	2,00	0,00	4,00	1,00	4,00
V18: Qualità dei pacchetti software inseriti (punti max 2)	2,00	0,00	2,00	1,00	2,00
V19: Efficacia diagnostica del sistema (punti max 5)	2,50	0,00	5,00	0,00	5,00

A. Olivero

SICUREZZA					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
V20: Caratteristiche del sistema di riduzione e monitoraggio della dose assorbita (punti max 3)	3,00	0,75	3,00	0,75	3,00
V21: Utilità delle altre caratteristiche progettuali finalizzate ad incrementare il livello di sicurezza dei sistemi (punti max 3)	1,50	0,75	2,25	0,75	3,00
FORMAZIONE					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste (punti max 3)	0,00	0,75	0,75	1,50	3,00
TOTALE					
	ASSING S.p.A.	GILARDONI S.p.A.	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	EUROIMAGING S.r.l.	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
	33,65	<u>20,28</u>	33,32	<u>24,36</u>	45,97


A. Orion

ALL.F

Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente al Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA1. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6.

VERBALE N. 7

Seduta del 26 giugno 2018

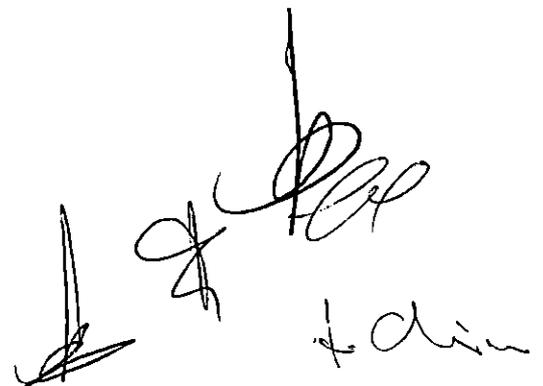Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and the name 'F. Di...' on the right.

L'anno 2018, il giorno 26 giugno alle ore 10.00 presso la UOC Ingegneria Clinica della ASL ROMA1 – Via Eugenio De Mattei, 72 – Pad. 90bis – si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice delle offerte, relative alla Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente al Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA1. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6.

La Commissione, nominata con deliberazione n. 747 DEL 25/07/2017 e con successiva delibera di modifica di sostituzione di un componente n. 313 del 28/03/2018 è così composta:

Presidente	Dott. Anastassios Chios	Dirigente Medico UOC Diagnostica N.R.M. ASL ROMA1
Componente	Dott. Carmine Ciaralli	Coord. Tecnico UOC Radiologia P.O. San Filippo Neri
Componente	Ing. Pietro Barberini	Direttore UOC Ingegneria Clinica
Segretario	Maria Pia Farallo	Coll. Amm.vo U.O.C. Ingegneria Clinica

A seguito del comunicato pubblicato in data 05/06/2018 sulla Sezione di Amministrazione Trasparente "Gare e Appalti" del sito aziendale www.aslroma1.it, le Società partecipanti sono state invitate a partecipare alla seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche.

Assistono alla seduta pubblica i rappresentanti delle società partecipanti, come indicato nell'allegato (Allegato 1).

A seguito delle richieste di proroga delle offerte inviate alle società partecipanti il 01/06/2018, scadute il 18 ottobre 2017, la Commissione prende atto delle proroghe delle stesse pervenute.

Successivamente, il Presidente constatata la regolarità della composizione della Commissione suindicata, inizia la seduta dando lettura pubblica dei punteggi tecnici definitivi attribuiti alle singole società partecipanti, come risulta dalla scheda riepilogativa allegata al presente verbale (Allegato 2).

Successivamente, la Commissione, dopo aver constatato l'integrità dei sigilli, procede, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Società ASSING S.p.A. SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. e GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. La Commissione non procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Società GILARDONI S.p.A. e EUROIMAGING S.r.l., in quanto a seguito della valutazione tecnica non hanno raggiunto il punteggio di 31/60 previsto dal CSA.

Il Presidente, pertanto, dà lettura degli importi relativi alle offerte economiche delle Società ammesse.

Conclusa la fase di apertura delle offerte economiche, il Presidente della Commissione alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta pubblica. La Commissione continua i lavori in seduta riservata, e provvede all'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche, secondo i criteri indicati all'art. 3 del CSA, e successivamente, tenuto conto dei punteggi quantitativi, provvede all'attribuzione dei punteggi definitivi alle singole Società partecipanti, come indicato nella scheda riepilogativa allegata al presente verbale (Allegato n. 3).



Alle ore 11.00 il Presidente riapre la seduta pubblica per comunicare ai rappresentanti delle ditte presenti i punteggi definitivi e l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara, secondo la graduatoria di seguito indicata:

SOCIETA'	IMPORTO IVA Esclusa	GRADUATORIA
GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.	€ 205.700,00	1°
ASSING S.p.A.	€ 195.300,00	2°
SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	€ 201.000,00	3°
GILARDONI S.p.A.		NON AMMESSA
EUROIMAGING S.r.l.		NON AMMESSA

La Commissione rileva che le offerte presentate dalle Società aggiudicatrici provvisoriamente risultano congrue, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e determina di rimettere gli atti al RUP per la valutazione delle eventuali anomalie delle offerte, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3, punto 5.3.


La Commissione propone l'aggiudicazione provvisoria alla Società GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. per un importo complessivo di € 205.700,00 IVA esclusa.

Il Presidente alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta, e rimette tutti gli atti di gara al RUP.


Le buste contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica relativa alla procedura di gara, sono custodite a cura del segretario nell'armadio situato presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Piazza S. Maria della Pietà, 5 – Pad. 90bis.

Il presente verbale, composto di n. 6 (sei) pagine di cui n. 3 (tre) pagine di allegati è letto, confermato e sottoscritto:


Presidente
Dott. Anastassios Chios



Componente
Dott. Carmine Ciaralli



Componente
Ing. Pietro Barberini



Segretario
Maria Pia Farallo



ALL. 1



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura "chiavi in mano" di n. 1 Telecomandato digitale diretto occorrente al P.O. N.R.M. della ASL ROMA1. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa.

3° Seduta pubblica del 26 giugno 2018 ore 10.00 – Apertura offerte economiche

Rappresentanti delle Società presenti:

DITTA	COGNOME NOME	DOCUMENTO	DE LE GA	FIRMA
ASSING S.p.A.				
EUROIMAGING				
G.M.M. S.p.A.				
GILARDONI S.p.A.				
SIEMENS S.r.l.	DANIELE FOSSATI PAOLO MORGANTI	V. ALLEGATI V. ALLEGATI	SI	 Paolo Morganti

LOTTO 1 - Tavola								
Telecomando digitale diretto: quantità 1.								
GENERATORE AD ALTA FREQUENZA E TUBO RX								
Parametri di valutazione qualitativi (punti max 60)	Parametro di valutazione	P. max	ASSING	GILARDONI	SIEMENS	EUROIMAGING	GMM	NOTE
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V1: potenza massima erogabile (in KW)	2	2	0	0	0	0	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V2: Numero massimo di immagini acquisite in grafia	3	3	0,29	0	0,5	1,57	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V3: Collimatore automatico con filtri addizionali motorizzati.	2	0,5	0,5	1,5	1,5	2	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V4: Distanza fuoco-film (in cm).	2	2	2	0	0	2	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V5: Acquisizione di proiezioni oblique.	1	1	1	1	1	1	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V6: Posizionamento automatico e/o motorizzato dello stativo in funzione alla tipologia d'esame.	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V7: Efficacia diagnostica del sistema composto da generatore e tubo radiogeno	6	2	1,25	4	2,25	6	
TAVOLO PORTAPAZIENTE								
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V8: Minima altezza da terra (in cm)	3	3	1,2	1,2	1,8	0	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V9: Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento (in Kg)	2	1,18	2	0	0,56	1,65	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V10: Altre caratteristiche del tavolo portapaziente.	3	0	0	2,25	2,25	3	
DETECTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL								
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V11: Dimensioni superficie attiva del detettore (in cm)	2	2	2	0,59	0	2	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V12: Dimensioni fisiche del pixel (in micron)	3	0	0	0	3	0	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V13: Efficacia diagnostica del sistema	3	2,25	2,25	2,25	3	2,25	
CONSOLE DI COMANDO E PREVIEW PER LA SALA COMANDO								
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V14: Doppia console di comando	2	2	2	2	2	2	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V15: Dimensioni del display (in pollici)	2	0	2	0	0	0	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V16: Capacità di archiviazione locale (espressa in numero di immagini archiviate)	1	0,22	0,04	0,03	0	1	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V17: Sistema di misurazione durante il processo di acquisizione dei dati	4	2	0	4	1	4	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V18: Qualità dei pacchetti software inseriti	2	2	0	2	1	2	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V19: Efficacia diagnostica del sistema	5	2,5	0	5	0	5	
SICUREZZA								
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V20: Caratteristiche del sistema di riduzione e monitoraggio della dose assorbita	3	3	0,75	3	0,75	3	
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	V21: Utilità delle altre caratteristiche progettuali finalizzate ad incrementare il livello di sicurezza del sistema.	3	1,5	0,75	2,25	0,75	3	
FORMAZIONE								
Addestramento e formazione del personale	VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	3	0	0,75	0,75	1,5	3	
ASSISTENZA TECNICA (punti max 5)								
Servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita.	Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai 24 richiesti	3	0		0		3	
Manutenzione straordinaria	TEMPI DI INTERVENTO RISOLUZIONE DEL GUASTO	2	2		1		1,5	
TOTALE PUNTEGGIO DEFINITIVO			35,65	20,28	34,32	24,36	50,47	GILARDONI E EUROIMAGING NON AMMESSE

pe

A. C...

ALL.3



Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 1 telecomandato digitale occorrente al NRM della ASL ROMA1. Importo annuo a base d'asta € 210.000,00 IVA esclusa.
CIG 6951732EB6

VALUTAZIONE COMPLESSIVA						
N.	DITTA	TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTI	NOTE
		PUNTI 60/100				
1	ASSING S.p.A.	35,65	€ 195.300,00	2,45	38,10	
2	GILARDONI S.p.A.	20,28				NON AMMESSA
3	EUROIMAGING S.r.l.	24,36				NON AMMESSA
4	SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.	34,32	€ 201.000,00	1,50	35,82	
5	GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.	50,47	€ 205.700,00	0,71	51,18	

La Commissione propone l'aggiudicazione alla Società GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. per un importo complessivo di € 205.700,00 IVA esclusa.


A. Chin

ALL. 8

**DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC INGEGNERIA CLINICA**

OGGETTO: Procedura Aperta, indetta con deliberazione n. 128 del 07/02/2017, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Tavolo telecomandato digitale diretto occorrente al Presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita della ASL ROMA1. Importo complessivo presunto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 6951732EB6.

Verifica congruità offerte.

In riferimento alle offerte presentate dalle ditte aggiudicatriche provvisoriamente, relative alla procedura di gara indicata in oggetto, si è proceduto alla verifica delle offerte anormalmente basse, di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

A seguito della suindicata verifica, così come rilevato anche dalla Commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi, si dichiara che le offerte presentate risultano congrue.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Pietro Barberini



Roma, 6.08.2018

L'estensore
Maria Pia Farallo

ALL. 9

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia Entrate
SEDCI/700
00023746
00101125
00101125
000008678
27/01/2017 08:44:33
58FF48F6948026CD
IDENTIFICATIVO : 0116000591426

0 1 16 000970 142 6



ALLEGATO "C"

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL ROMA 1 - LOTTO N. 1 - CIG 6951732EB6

TABELLA OFFERTA PREZZO LOTTO N. 1

Il sottoscritto **PIERLUIGI CARRARO** legale rappresentante della Ditta **GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.**, con sede in **SERIATE (BG) Via PARTIGIANI N. 25**

DICHIARA

Che la Ditta che LEGALMENTE rappresenta, è disposta ad eseguire tutte le prestazioni e forniture indicate nel Bando e nella documentazione della Gara in oggetto, alle condizioni tutte ivi previste nonché quanto offerto nel proprio Progetto Offerta, che è parte integrante e sostanziale della presente, relative al Lotto 1 - fornitura di n° 1 Tavolo Telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per immagini del P.O. Nuovo Regina Margherita della ASL Roma 1, applicando all'importo globale posto a base d'asta il ribasso percentuale di 2,05 % (diconsi euro due e centesimi cinque, per ogni cento euro). Tale ribasso è frutto di calcolo ponderale che tiene conto dei prezzi netti che si offrono e dei costi per gli oneri della sicurezza e per i rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

Pertanto l'offerta economica globale, al netto dell'IVA è € 205.700,00 (diconsi euro duecentocinquemilasettecento/00)

Tale importo offerto è composto come da seguente prospetto:

imp. globale netto forn. e montaggio attrezz. e accessori (esci. IVA)	€ 191.450,00
importo globale netto dei lavori edili, impiantistici e accessori (esci. IVA)	€ 10.000,00
importo globale degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.750,00
oneri di progettazione	€ 1.500,00
importo totale offerto (esc. IVA)	€ 205.700,00

In caso di aggiudicazione il sottoscritto **PIERLUIGI CARRARO**, legale rappresentante della Ditta, prima della stipula del contratto, si impegna, se richiesto, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, ad integrare le analisi dimostrative contenenti i costi della mano d'opera e dei materiali, le spese generali e l'utile dell'impresa, in base ai quali è pervenuto alla formulazione della presente offerta.

La presente offerta si intende onnicomprensiva di forniture, montaggi, trasporti, noli, lavori edili e impiantistici, eventuali integrazioni di opere, necessarie comunque a dare le forniture e le opere perfettamente complete, funzionanti e rispondenti a tutte le prescrizioni di capitolato ed alle caratteristiche del progetto offerta che forma parte integrante e sostanziale della presente offerta economica, ed alle normative in vigore comunque alla data della certificazione di collaudo

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA/ATI
Firma del Legale Rappresentante

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dott. Pierluigi Carraro

PROCURATORE
/PROCURATORE
N. AS9498621 Rilasciato il 30/12/2011

Si allega fotocopia del documento di identità del firmatario della presente offerta economica : doc. CARTA D'IDENTITA' N. AS9498621 Rilasciato il 30/12/2011
Si allega elenco specifico delle apparecchiature offerte, con l'indicazione dei singoli prezzi netti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso per la perfetta funzionalità

A. Carraro



GMM

Spett.le.....
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1.....
Borgo Santo Spirito n.3.....
00193 ROMA (RM).....

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura
"chiavi in mano" di apparecchiature elettromedica-
li occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalie-
ri della ASL ROMA 1.....
Lotto n. 1 - Codice CIG: 6951732EB6.....

La sottoscritta societa' General Medical Merate
S.p.A. con sede in Seriate (BG) via Partigiani 25,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 00225500164
partecipa all'appalto in oggetto con la presente
offerta:.....

OFFERTA N. 017059/GG/fs del 15/03/2017.....

TOTALE OFFERTA ECONOMICA GLOBALE.....
I.V.A. ESCLUSA EURO 205.700,00
..... (duecentocinquemilasettecento/00)
pari a ribasso percentuale su importo globale

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dott. PIERLUIGI CARRARO
PROCURATORE

General Medical Merate S.p.A.
Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
Mincom N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com





Handwritten initials: J O

GMMFFERTA N. 017059 Foglio N. 2 del 15/03/2017

posto a base d'asta 2,05 %

.....(duevirgolazerocinquepercento)

così composto:.....

IMPORTO GLOBALE OFFERTA PER FORNITURA E MONTAGGIO
ATTREZZATURE E ACCESSORI I.V.A. ESCLUSA.....

.....EURO 191.450,00

.....(centonovantaunomilaquattrocentocinquanta/00)

COMPENSIVO DI EURO 1.914,50 (millenovecentoquatt-
ordici/50) PER I COSTI SOSTENUTI PER LA SICUREZZA
DEI PRODOTTI E DEI LAVORATORI.....

(ART. 97 C.6 DEL D.LGS. 50/2016).....

IMPORTO GLOBALE OFFERTA DEI LAVORI EDILI, IMPIAN-
TISTICI E ACCESSORI.....

* VEDASI IN DETTAGLIO ALLEGATO COMPUTO METRICO *..

.....EURO 10.000,00

.....(diecimila/00)

COMPENSIVI DI:.....

- ONERI DELLA SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZA.

..NON SOGGETTI A RIBASSO.....

Handwritten signature: A. Zenoni

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dott. PIERLUIGI CARRARO
PRODOTTORE





GMMFFERTA N. 017059 Foglio N. 3 del 15/03/2017

..IMPORTO GLOBALE EURO 2.750,00

.....(duemilasettecentocinquanta/00)

- ONERI DI PROGETTAZIONE EURO 1.500,00

.....(millecinquecento/00)

Di seguito in dettaglio l'elenco specifico delle apparecchiature e accessori offerti:.....

N. 1 GENERATORE CASTOR HF 80 TS.....

Generatore ad alta frequenza 80 kW.....

per applicazioni RAD/FLUORO.....

Potenza massima: 80 kW.....

Corrente massima: 1.000 mA.....

Minimo tempo di esposizione: 0,001 s.....

Tensione massima di grafia: 150 kV.....

Corrente massima di scopia: 0,1 - 8 mA.....

Tensione massima di scopia: 40 - 120 kV.....

Corrente massima in scopia pulsata: fino a 40 mA..

Completo di.....

* CONFIGURAZIONE PER DUE TUBI (HF).....

* STARTER DSS (10.000 g./min) (HF).....

* INTERFACCIA HIRIS RF43 (CASTOR HF).....

* CAVI DI CONNESSIONE 20 m.....

Handwritten signature

A. C...

Handwritten signature

Handwritten signature

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dott. PIERLUIGI CANTARO
PROCURATORE

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com





GMM OFFERTA N. 017059 Foglio N. 4 del 15/03/2017

- * INTERFACCIA DAP (CASTOR HF).....
- * CAMERA DAP VACUDAP 2004.....
- * CAVO PER CAMERA DAP 25 m (CASTOR).....
- * SCHEDA AEC - 1 CAMERA (CASTOR HF).....

IMPORTO AL NETTO DI I.V.A. EURO 16.310,00
(sedicimilatrecentodieci/00)

- N. 1 CLISIS EXEL DRF Tav.telecom.90°/90°.....
- Piano portapaziente a sbalzo in.....
- fibra di carbonio. Accessibile ai.....
- quattro lati, altezza variabile.....
- Tavolo telecomandato ad altezza variabile con.....
- ribaltamento 90/90 controllato a microprocessori..
- Piano-portapaziente in fibra di carbonio accessibi
- ai quattro lati, peso massimo paziente 200Kg senza
- limiti operativi.....
- Sistema di acquisizione dell'immagine con.....
- detettore digitale dinamico e dispositivo di.....
- griglia autofocalizzante.....
- Tomografia con variazione pre-programmata del.....
- piano di taglio.....
- Completo di.....
- * COLLIMATORE AUT. FILTRI MOT.....



Handwritten signature

Handwritten signature

A. Qui...

Handwritten signature

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
 Dott. PIERLUIGI CARRARO
 PROCURATORE

General Medical Merate S.p.A.
 Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
 Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
 Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
 Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
 Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
 Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
 C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
 www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com





GMMAFFERTA N. 017059 Foglio N. 5 del 15/03/2017

- * CONSOLLE C/TOUCH SCREEN GENERATORE.....
- * ANCORAGGIO CON PIASTRA DI BASE.....
- * KIT TRASPORTO/INSTALLAZIONE CLISIS.....
- * PEDANA PIANO PORTAPAZ.FIBRA CARBON.....
- * PIANO PORTA PAZIENTE FIBRA CARBONIO.....
- * CAVO INTERFACCIA V/CASTOR 15 m.....
- * IMBALLO NORMALE.....
- * GRIGLIA R12/L200/F150.....
- * FLANGIA ROTAZIONE COLLIMATORE.....
- * CAMERA TV VISUALIZZAZIONE PAZIENTE.....
- * PEDALI SCOPIA/GRAFIA-SALA ESAMI.....
- * PEDALI SCOPIA/GRAFIA - SALA COMANDO.....
- * TENDIFASCIA.....
- * REGGIGAMBE.....
- * STAFFA SUPPORTO CARTA.....
- * SCRIVANIA PER SISTEMI DR.....
- * KIT PER LATTANTI.....
- * CULLA PER BAMBINI FINO A 5 ANNI.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A. Uiso

IMPORTO AL NETTO DI I.V.A. EURO 64.310,00
.....(sessantaquattromilatrecentodieci/00)

N. 1 HIRIS RF43 Sistema digitale RF.....
Sistema di acquisizione ed elab.....

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com

[Handwritten signature]
GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dott. EIERLUIGI CARRARO
PROCURATORE





GMMFFERTA N. 017059 Foglio N. 6 del 15/03/2017

Handwritten initials/signature in the top right corner.

- immagini radio-fluorografiche.....
- DICOM package e AEC.....
- Sistema digitale per acquisizione ed elaborazione.
- di immagini radio-fluorografiche.....
- Completo di detettore digitale PIXIUM RF4343,.....
- DICOM PACKAGE, AEC e Camera di Ionizzazione.....
- Completo di.....
- * MONITOR LCD 19" MONOCROMATICO (T).....
- * ESTENSIONE HARD DISK A 2 TB.....
- * RICOSTRUZIONE IMMAGINI.....
- * MODULO PER MISURAZIONI ORTOPEDICHE.....
- * DICOM CD/DVD.....
- * DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT.....
- * CAVO MONITOR 15 m.....
- * SUPPORTO MONITOR.....
- * MONITOR LCD 19" MONOCROMATICO (T).....
- * CAVO MONITOR 15 m.....
- * CARRELLO SUPPORTO MONITOR.....
- * GRUPPO DI CONTINUITA' (SL).....
- * MODULO ANGIO.....
- * DICOM 3.0 QUERY/RETRIEVE.....
- * DICOM 3.0 REPORT MONITORAGGIO DOSE.....

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

.IMPORTO AL NETTO DI I.V.A. EURO 100.950,00

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
 Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
 Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
 Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
 Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
 Mincom N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
 C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
 www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
 Dott. PIERLUIGI CARRARO
 PROCURATORE





GMM OFFERTA N. 017059 Foglio N. 7 del 15/03/2017

Handwritten signature

.....(centomilanovecentocinquanta/00)

.N. 1 RTC 700HS/C52S 0.6/1.0 40/80.....

.Complesso radiogeno con tubo bifocale ad anodo...

.rotante in renio-tungsteno-molibdeno e grafite...

.9000 giri/min inserito in guaina C52Super.....

.Fuochi: 0.6/1.0 mm.....

.Potenza: 40/80 kW.....

.Tensione massima: 150 kV.....

.Inclinazione anodo: 12.5 °.....

.max capacità termica anodo 800 kUT (600kJ).....

.max dissipazione continua anodica: 1.000 W.....

.max capacità termica guaina 1.700 kUT(1.280kJ)..

.max dissipazione continua guaina senza ventilator

.306 UT/s (230W).....

.max dissipazione continua guaina con ventilatore.

.492 UT/s (370W).....

Completo di.....

* PROLUNGAMENTO LINEA AT coppia 16 m.....

IMPORTO AL NETTO DI I.V.A. EURO 5.220,00

.....(cinquemiladuecentoventi/00)

N. 1 Quadro elettrico sala telecomandata diretta.

Handwritten signature

Handwritten signature

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dott. PIERLUIGI CARRARO
PROCURATORE

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com



Handwritten mark



GMM AFFERTA N. 017059 Foglio N. 8 del 15/03/2017

.....
IMPORTO AL NETTO DI I.V.A. EURO 4.010,00
.....(quattromiladieci/00)

N. 2 SEDIE CON ROTELLE PER CONSOLLE.....

.....
IMPORTO AL NETTO DI I.V.A. EURO 400,00
.....(quattrocento/00)

N. 1 ACCESSORIO PER DEFECOGRAFIE.....

.....
IMPORTO AL NETTO DI I.V.A. EURO 250,00
.....(duecentocinquanta/00)

.....La General Medical Merate S.p.A.....

.....DICHIARA.....

che non vi sono ulteriori accessori opzionali disponibili, oltre a quelli già presenti nell'apparecchiatura in configurazione di offerta.....

NOTA: Le apparecchiature offerte non necessitano di materiale di consumo, ad eccezione del normale utilizzo di energia elettrica, di pellicole radiografiche e di carta per stampante termica reperibili.....

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
Mincom N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dott. PIERLUIGI CARRARO
PROCURATORE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
A. Clivio



GMM OFFERTA N. 017059 Foglio N. 9 del 15/03/2017

bili sul mercato presso qualsiasi ditta produttrice o fornitrice delle stesse secondo il carico di lavoro del reparto utilizzatore.....

=====

Trattandosi di documento economico amministrativo, la composizione delle apparecchiature offerte e' stata redatta in modo sintetico e con riferimento ai componenti di base.....

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dettagliate, Vi rimandiamo alle allegare schede e relativi deplianti.....

CONDIZIONI FORNITURA.....

Validità preventivo : 180 giorni dal 18/04/2017..

Imballo e trasporto : compresi.....

Montaggio e collaudo: compresi.....

Progetti d'installazione: gratuiti a cura ns.Ufficio Tecnico.....

Uffici Assistenza: Roma - via Tiraboschi, 7B.....

Tempo intervento:Entro 2 ore lavorative dalla chiamata.....

Disponibilità ricambi: 10 anni dalla consegna.....

Garanzia: 36 mesi integrale "Full-Risk" data collaudo positivo.....

Handwritten signature

Handwritten signature

A-005

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com

Handwritten signature
GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dott. PIETRUCCIO CARRARO
PROCURATORE





GMMFFERTA N. 017059 Foglio N. 10 del 15/03/2017

Tempi di consegna: entro 40gg.naturali consecutivi

Pagamento : BB 60GG DFFM.....

IVA di legge a Vostro carico.....

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.....

Dott. Pierluigi Carraro.....

Procuratore.....

Handwritten signature

Handwritten mark

A cura

Handwritten signature

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
Dott. PIERLUIGI CARRARO
PROCURATORE

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787
Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - ITALIA - Tel. +39 080 763121 - Fax +39 080 764306
Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - Tel. +39 06 8274437 - Fax +39 06 8274455
Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016
www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com





GENERAL MEDICAL MERATE S.p.a.

Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) Italia
tel +39 035 4525311 fax +39 035 297787

- A. S. L. ROMA 1 -

Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura "chiavi in mano" di apparecchiature elettromedicali occorrenti alle esigenze della Azienda ASL ROMA1

LOTTO N.1 : TAVOLO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO - P.O. NUOVO REGINA MARGHERITA (codice elaborati grafici di progetto : 17020)

Codice	Descrizione	Um	Q.tà (A)	Importo unitario (B)	Importo totale (C=AxB)
OPERE PROVVISORIALI e di SICUREZZA					
OP1	Approntamento cantiere, opere provvisoriale e di sicurezza. Approntamento del cantiere e opere provvisoriale di protezione delle aperture di comunicazione delle zone di lavoro del cantiere e delle aree operative dalle zone circostanti, delimitazione dei percorsi interni e di avvicinamento, cartelli di segnalazione, smobilizzo e ripristino area. Sezionamento di tutti gli impianti esistenti, interni all'area di intervento e predisposizione degli impianti.	a corpo	1,0	€ 650,00	€ 650,00
duvri	Oneri di sicurezza e rischi di interferenza		1,0	€ 2.100,00	€ 2.100,00
TOTALE OPERE PROVVISORIALI e di SICUREZZA					€ 2.750,00
OPERE EDILI VARIE					
DM1	Rimozione con recupero infissi esistenti. Rimozione e recupero delle porte esistenti nei locali oggetto di intervento.	a corpo	1,0		
DM2	Rimozione e smaltimento zoccolino a pavimento ceramico. Rimozione e smaltimento zoccolino a pavimento ceramico perimetrale nella Diagnostica. Compreso carico, trasporto e smaltimento. Locali Diagnostica e Comandi.	ml.	20,0		
PR1	Sistemazione sottofondo area di fissaggio nuova apparecchiatura. Opere edili per il fissaggio della piastra di base della nuova apparecchiatura telecomandata, a seguito dello smontaggio di quella esistente, comprensivo delle opere per eventuale fissaggio su telaio piastra esistente o rimozione, l'eventuale sistemazione di sottofondo di pavimento da rendere idoneo al fissaggio. Compreso ogni onere e magistero a realizzare il lavoro a regola d'arte.	a corpo	1,0		
ED1	Preparazione alla nuova pavimentazione : stesura di autolivellante. Esecuzione di autolivellante a pavimento liscio e tirato a spatola per formazione superficie liscia idonea alla posa di pavimento in pvc linoleum. Locali Diagnostica e Comandi.	mq.	32,0		
ED2	Nuovo pavimento in pvc teli sp. 2 mm. Fornitura e posa in opera di pavimento in teli vinilici antistatico, antiscivolo omogeneo, coestruso, presso/calandrato, flessibile, saldabile, decoro venato. Compresa sigillatura a caldo dei giunti orizzontali e verticali. Spessore mm 2 - teli h. 200 cm. Linoleum tipo marmorizzato spess. 2 mm. Locali Diagnostica e Comandi.	mq.	32,0		
ED3	Battiscopa perimetrale in pvc. Fornitura e posa di battiscopa perimetrale in pvc. Compreso di ogni onere e magistero. Locali Diagnostica e Comandi.	ml	20,0		
ED7	Tinteggiatura interna. Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni : carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili. Sulle superfici libere da rivestimenti. Locali Diagnostica e Comandi.	mq.	60,0		
ED8	Posa in opera infissi recuperati precedentemente rimossi. Ripristino porte interne precedentemente rimosse. Compreso di ogni onere e magistero alla completa posa in opera.	a corpo	1,0		
TOTALE OPERE EDILI VARIE					
IMPIANTI ELETTRICI					
EL1	Posa Quadro Elettrico per Apparecchiatura radiologica. Posa nuovo Quadro Elettrico per alimentazione nuova apparecchiatura Rx. Compreso i cablaggi, cavi e certificazione.	a corpo	1,0		
EL2	Canalizzazioni di collegamento per il nuovo impianto Radiologico. Verifica per riutilizzo delle canaline esistenti per il collegamento della nuova apparecchiatura Rx dal Q.Elettrico. Adeguamento con nuove di tipo ispezionabili a pavimento con coperchio rimovibile da rivestire con la nuova pavimentazione. Inclusa assistenza muraria. Compreso la rimozione di quelle esistenti non idonee, le opere di demolizione del sottofondo per realizzazione delle tracce, lo smaltimento del materiale di risulta e di ogni altro onere e magistero.	a corpo	1,0		
EL3	Impianto rete comunicazione dati. Realizzazione di N.2 punti prese comunicazione dati in Diagnostica.	a corpo	1,0		

A. Cusi

GENERAL MEDICAL MERATE S.p.a.
 DON BIZZUCCI GAZZARO
 PROCURATORE

EL4	Impianto di segnalazione accesso controllato sala radiologica. Verifica e adeguamento impianto accesso gestito della Diagnostica completo di microswitch e lampade di segnalazione luce Bianca/Rossa, pulsanti di emergenza, Compeso cablaggi, derivazioni, cavi e cavidotti.	a corpo	1,0		
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI					
VARIE					
VA	Oneri di progettazione		1,0	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE LAVORI SENZA ONERI PER LA SICUREZZA					
					€ 11.500,00
TOTALE OPERE PROVISIONALI E DI SICUREZZA					
					€ 2.750,00
TOTALE LAVORI CON ONERI SICUREZZA					
					€ 14.250,00

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: A. Cui 5

GENERAL MEDICAL MIRATE S.p.A.
Dott. *F. C. ...*
PROCURATORE