

LOTTO 14

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

LOTTO 14

<b>Ditta concorrente</b>	APPLIED MEDICAL	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Biocompatibilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la biocompatibilità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Resistenza meccanica ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la resistenza meccanica.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità e tollerabilità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

Elemento di valutazione	6.	Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	Motivazione	Coefficiente
Commissione		La Commissione valuta OTT/MI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.		1,00
Elemento di valutazione	7.	Istruzioni per l'uso (D)	Motivazione	Coefficiente
Commissione		La Commissione valuta OTT/MI le istruzioni per l'uso.		1,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

LOTTO 14

<b>Ditta concorrente</b>	<b>ALL MEDICAL</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Biocompatibilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la biocompatibilità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Resistenza meccanica ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta DISCRETA la resistenza meccanica dalla visione della campionatura.	0,40
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità e tollerabilità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

LOTTO 14

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

LOTTO 14

<b>Ditta concorrente</b>	<b>MEDLINE</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Biocompatibilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la biocompatibilità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Resistenza meccanica ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta DISCRETA la resistenza meccanica dalla visione della campionatura.	0,40
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIAM la Praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità e tollerabilità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

LOTTO 14

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio (D)	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso (D)	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



LOTTO 15

<b>Ditta concorrente</b>	<b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Adattabilità al sito anatomico ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'adattabilità al sito anatomico.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Maneggevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la maneggevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di posizionamento ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di posizionamento.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di utilizzo ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00

Handwritten signatures and initials, including a stylized signature on the left and a larger signature on the right.



LOTTO 15

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Facilità di apertura	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Robustezza	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la robustezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	8. Istruzioni per l'uso	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00




LOTTO 15

<b>Ditta concorrente</b>	APPLIED MEDICAL	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Adattabilità al sito anatomico ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'adattabilità al sito anatomico.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Maneggevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la maneggevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di posizionamento ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di posizionamento.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di utilizzo ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00

Handwritten signatures and initials, including what appears to be 'R/A' and a stylized signature.

LOTTO 15

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Facilità di apertura	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Robustezza	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la robustezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	8. Istruzioni per l'uso	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00




LOTTO 17

<b>Ditta concorrente</b>	ESSEPI	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Scorrevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Memoria di forma ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Facilità di rilascio e posizionamento ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Radiopacità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

LOTTO 17

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

*Handwritten signature*


*Handwritten mark*

LOTTO 17

<b>Ditta concorrente</b>	COOK ITALIA SRL	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Scorrevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Memoria di forma ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Facilità di rilascio e posizionamento ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Radiopacità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

LOTTO 17

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso ( D ).	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

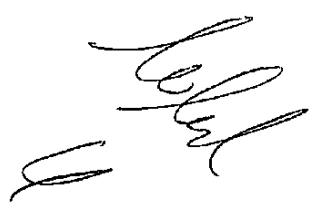

LOTTO 18

<b>Ditta concorrente</b>	ESSEPI	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Conformazione del cestello ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la conformazione del cestello.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Memoria di forma ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Atraumaticità della punta	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità della punta in quanto di tipologia no-tip.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di impugnatura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di impugnatura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



LOTTO 18

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

LOTTO 18



<b>Ditta concorrente</b>	<b>COLOPLAST</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Conformazione del cestello ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la conformazione del cestello.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Memoria di forma ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Atraumaticità della punta	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità della punta in quanto di tipologia no-tip.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di impugnatura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di impugnatura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00




LOTTO 18

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00





LOTTO 18

<b>Ditta concorrente</b>	TAU MEDICA	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Conformazione del cestello ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la conformazione del cestello.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Memoria di forma ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Atraumaticità della punta	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta SUFFICIENTE l'atraumaticità della punta per la sua conformazione rigida.	0,20
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di impugnatura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di impugnatura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

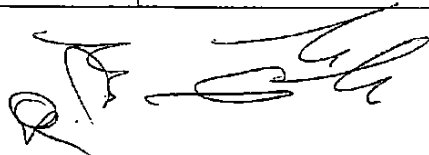

LOTTO 18

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00






LOTTO 19

<b>Ditta concorrente</b>	ESSEPI	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Scorrevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la scorrevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Memoria di forma ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la memoria di forma.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Facilità di rilascio e posizionamento ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Facilità di rilascio e posizionamento.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Radiopacità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

Handwritten signatures and initials, including what appears to be 'RTE' and a stylized signature.

LOTTO 19

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



LOTTO 20

<b>Ditta concorrente</b>	ESSEPI	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Atraumaticità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Assemblaggio componenti ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Scorrevolezza e maneggevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di utilizzo ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.



LOTTO 20

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



LOTTO 21



<b>Ditta concorrente</b>	<b>ESSEPI</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Atraumaticità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' atraumaticità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Assemblaggio componenti ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Scorrevolezza e maneggevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di utilizzo ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



LOTTO 21

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

LOTTO 21

<b>Ditta concorrente</b>	COOK ITALIA	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Atraumaticità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' atraumaticità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Assemblaggio componenti ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Scorrevolezza e maneggevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di utilizzo ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

LOTTO 21


<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



LOTTO 21




<b>Ditta concorrente</b>	BARD	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Atraumaticità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Assemblaggio componenti ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Scorrevolezza e maneggevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di utilizzo ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



LOTTO 21

Elemento di valutazione	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
Elemento di valutazione	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

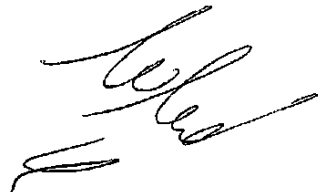

LOTTO 21

<b>Ditta concorrente</b>	<b>COLOPLAST</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Atraumaticità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' atraumaticità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Assemblaggio componenti ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Scorrevolezza e maneggevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di utilizzo ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00



LOTTO 21

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*

LOTTO 21

<b>Ditta concorrente</b>	<b>OLYMPUS</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Atraumaticità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' atraumaticità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Assemblaggio componenti ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'assemblaggio componenti.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Scorrevolezza e maneggevolezza ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la Scorrevolezza e maneggevolezza.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità di utilizzo ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di utilizzo.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00

Handwritten signatures and initials, including what appears to be 'RT' and a cursive signature.

LOTTO 21

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00




LOTTO 22

<b>Ditta concorrente</b>	ESSEPI	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Biocompatibilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la biocompatibilità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Resistenza meccanica ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la resistenza meccanica.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Intuitività ed efficienza del sistema di gonfiaggio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' Intuitività ed efficienza del sistema di gonfiaggio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' atraumaticità e tollerabilità.	1,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials 'RTA' on the left.

LOTTO 22

<b>Elemento di valutazione</b>	<b>6. Facilità di apertura ( D )</b>	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	<b>7. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )</b>	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	<b>8. Istruzioni per l'uso ( D )</b>	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

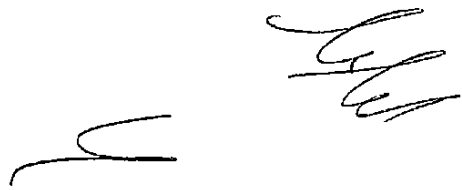


LOTTO 22

<b>Ditta concorrente</b>	<b>BARD</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Biocompatibilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la biocompatibilità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Resistenza meccanica ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la resistenza meccanica.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Intuitività ed efficienza del sistema di gonfiaggio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' Intuitività ed efficienza del sistema di gonfiaggio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' atraumaticità e tollerabilità.	1,00

LOTTO 22

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	8. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



LOTTO 22

<b>Ditta concorrente</b>	OLYMPUS	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Biocompatibilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la biocompatibilità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Resistenza meccanica ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la resistenza meccanica.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Intuitività ed efficienza del sistema di gonfiaggio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' Intuitività ed efficienza del sistema di gonfiaggio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l' atraumaticità e tollerabilità.	1,00

*RTA*

*MMP*





LOTTO 22

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	8. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00



LOTTO 23

<b>Ditta concorrente</b>	<b>COOK ITALIA</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Morbidezza/scorrevolezza del catetere ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMO la morbidezza/scorrevolezza del catetere per la punta molto morbida che consente una ottima morbidezza/scorrevolezza del catetere.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Radiopacità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità della lettura della centimetratura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità della lettura della centimetratura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità e tollerabilità per la punta molto atraumatica che consente una ottima atraumaticità e tollerabilità.	1,00

LOTTO 23

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	8. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00







LOTTO 23

<b>Ditta concorrente</b>	<b>ALL MEDICAL</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Morbidezza/scorrevolezza del catetere ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta SUFFICIENTE la morbidezza/scorrevolezza del catetere per la punta poco morbida che consente una sufficiente morbidezza/scorrevolezza del catetere.	0,20
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Radiopacità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità della lettura della centimetratura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità della lettura della centimetratura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta SUFFICIENTE l'atraumaticità e tollerabilità per la punta poco atraumatica che consente una sufficiente atraumaticità e tollerabilità.	0,20

LOTTO 23

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	8. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00





LOTTO 23

<b>Ditta concorrente</b>	<b>COLOPLAST</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Morbidezza/scorrevolezza del catetere ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta SUFFICIENTE la morbidezza/scorrevolezza del catetere per la punta poco morbida che consente una sufficiente morbidezza/scorrevolezza del catetere.	0,20
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Radiopacità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta SUFFICIENTE la praticità di inserimento e rimozione in quanto i fili guida scorrono con difficoltà.	0,20
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità della lettura della centimetrazione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità della lettura della centimetrazione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità e tollerabilità per la punta molto atraumatica che consente una ottima atraumaticità e tollerabilità.	1,00

LOTTO 23

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	8. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00




LOTTO 24

<b>Ditta concorrente</b>	<b>COOK ITALIA</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Morbidezza/scorrevolezza del catetere ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta <b>OTTIMA</b> la morbidezza/scorrevolezza del catetere per la punta molto morbida che consente una ottima morbidezza/scorrevolezza del catetere.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Radiopacità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta <b>OTTIMA</b> la radiopacità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta <b>OTTIMA</b> la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità della lettura della centimetratura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta <b>OTTIMA</b> la facilità della lettura della centimetratura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta <b>OTTIMA</b> l'atraumaticità e tollerabilità per la punta molto atraumatica che consente una ottima atraumaticità e tollerabilità.	1,00



LOTTO 24

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	8. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

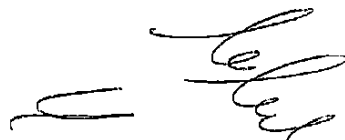

LOTTO 24

<b>Ditta concorrente</b>	BARD	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Morbidezza/scorrevolezza del catetere ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta SUFFICIENTE la morbidezza/scorrevolezza del catetere per la punta poco morbida che consente una sufficiente morbidezza/scorrevolezza del catetere.	0,20
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Radiopacità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità della lettura della centimetratura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta NON SUFFICIENTE/NON VALUTABILE la facilità della lettura della centimetratura in quanto il dispositivo offerto non dispone della lettura della centimetratura.	0,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta SUFFICIENTE l'atraumaticità e tollerabilità per la punta poco atraumatica che consente una sufficiente atraumaticità e tollerabilità.	0,20

LOTTO 24

<b>Elemento di valutazione</b>	6. Facilità di apertura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la facilità di apertura.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	7. Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMI gli accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	8. Istruzioni per l'uso ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIME le istruzioni per l'uso.	1,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

LOTTO 24

<b>Ditta concorrente</b>	<b>OLYMPUS</b>	
<b>Elemento di valutazione</b>	1. Morbidezza/scorrevolezza del catetere ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la morbidezza/scorrevolezza del catetere per la punta molto morbida che consente una ottima morbidezza/scorrevolezza del catetere.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	2. Radiopacità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la radiopacità.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	3. Praticità di inserimento e rimozione ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA la praticità di inserimento e rimozione.	1,00
<b>Elemento di valutazione</b>	4. Facilità della lettura della centimetratura ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta NON SUFFICIENTE/NON VALUTABILE la facilità della lettura della centimetratura in quanto il dispositivo offerto non dispone della lettura della centimetratura.	0,00
<b>Elemento di valutazione</b>	5. Atraumaticità e tollerabilità ( D )	
	<b>Motivazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Commissione</b>	La Commissione valuta OTTIMA l'atraumaticità e tollerabilità per la punta molto atraumatica che consente una ottima atraumaticità e tollerabilità.	1,00